
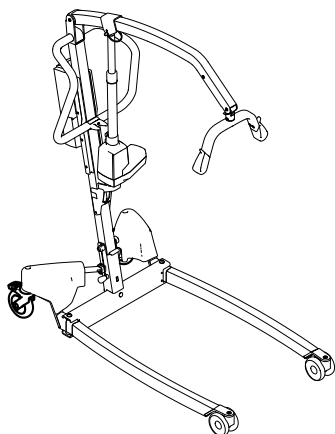
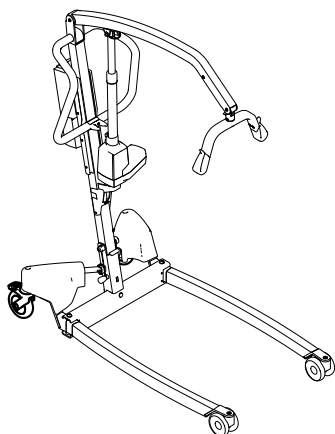
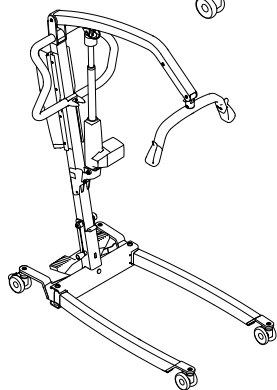


Invacare® Birdie® EVO

Birdie® EVO, Birdie® EVO COMPACT, Birdie® EVO PLUS,
Birdie® EVO XPLUS

nl **Mobiele patiëntenlift** **Gebruiksaanwijzing**

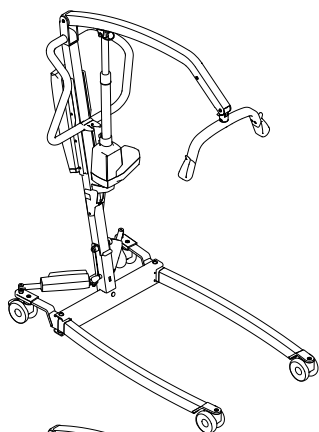

Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker van het product.
Lees deze handleiding VOORDAT u dit product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



Yes, you can.®

©2023 Invacare Corporation

Alle rechten voorbehouden. Herpublicatie, duplicatie of gehele of gedeeltelijke wijziging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan ™ en ®. Alle handelsmerken zijn eigendom van of gelicentieerd aan Invacare Corporation of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven.

Inhoudsopgave

1 Algemeen	4	7.2 De mast losmaken van het onderstel	27
1.1 Inleiding	4	7.3 De mast inklappen	27
1.1.1 Symbolen in dit document	4	7.4 Mastverlengstuk voor rechtop zetten van de lift	27
1.2 Levensduur	4	8 Onderhoud	28
1.2.1 Aanvullende informatie	4	8.1 Algemene informatie over onderhoud	28
1.3 Aansprakelijkheidsbeperking	4	8.2 Dagelijkse controles	28
1.4 Garantie-informatie	4	8.3 Reiniging en desinfectie	28
1.5 Naleving	4	8.3.1 Algemene veiligheidsinformatie	28
1.5.1 Productspecifieke normen	5	8.3.2 Reinigingsintervallen	28
2 Veiligheid	6	8.3.3 Reinigingsinstructies	29
2.1 Algemene veiligheidsinformatie	6	8.3.4 Instructies voor desinfecteren	29
2.1.1 Klempunten	7	8.4 Periodiek onderhoud	29
2.2 Veiligheidsinformatie over accessoires	7	9 Na gebruik	30
2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie	7	9.1 Afvoeren	30
2.4 Typeplaatjes en symbolen op het product	8	9.2 Geschikt maken voor hergebruik	30
2.4.1 Locatie van label	8	10 Problemen oplossen	31
2.4.2 Typeplaatje	8	10.1 Defecten en mogelijke oplossingen identificeren	31
2.4.3 Overige labels en symbolen	8	11 Technische Specificaties	32
3 Productoverzicht	10	11.1 Maximale veilige belasting	32
3.1 Bedoeld gebruik	10	11.2 Afmetingen en gewichten	32
3.2 Hoofdonderdelen van de lift	10	11.3 Elektrisch systeem	33
3.3 Accessoires	11	11.4 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving	34
4 Montage	12	11.5 Materialen	34
4.1 Algemene veiligheidsinformatie	12	11.6 Duwkracht op bedieningselementen	34
4.2 Omvang van de levering	12	12 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	35
4.3 De mast installeren	12	12.1 Algemene informatie over EMC	35
4.3.1 De mast uitklappen	12	12.2 Elektromagnetische straling	35
4.3.2 De mast op het onderstel monteren	13	12.3 Elektromagnetische immuniteit	35
4.4 Het tiljuk uitklappen	13		
4.5 De actuator op de hefboom installeren	14		
4.6 Hendel voor handmatig uitklappen van poten installeren	14		
4.7 De serviceteller resetten	15		
5 Gebruik	16		
5.1 Algemene veiligheidsinformatie	16		
5.2 De achterste zwenkwielen vergrendelen/ontgrendelen	16		
5.3 Een elektrische lift omhoog of omlaag brengen	16		
5.4 De poten inklappen en uitklappen	16		
5.4.1 De elektrische poten in- en uitklappen	16		
5.4.2 De poten handmatig in- en uitklappen	16		
5.5 Het tiljuk vervangen	17		
5.6 Functies voor noodgevallen	17		
5.6.1 Een noodstop uitvoeren	17		
5.6.2 De verlagingsfunctie activeren in een noodgeval (CBJ Home-bedieningseenheid)	17		
5.6.3 De verlagingsfunctie activeren in een noodgeval (bedieningseenheid van CBJ Care, CBJ1 en CBJ2)	17		
5.6.4 De optilfunctie activeren in een noodgeval (bedieningseenheid van CBJ Care en CBJ1)	18		
5.6.5 Het verlagingsmechanisme activeren in een noodgeval	18		
5.7 De accu opladen	18		
5.7.1 CBJ Home-bedieningseenheid	19		
5.7.2 CBJ Care-, CBJ1-, CBJ2-bedieningseenheid	19		
5.7.3 Optionele handbediening	19		
5.7.4 Optionele acculader	20		
6 Verplaatsen van een patiënt	21		
6.1 Algemene veiligheidsinformatie	21		
6.2 Het omhoog tillen voorbereiden	21		
6.2.1 De draagband aan de patiëntenlift bevestigen	22		
6.3 De patiënt vanaf een bed verplaatsen	23		
6.4 Een patiënt naar een bed verplaatsen	24		
6.5 Een patiënt overplaatsen vanuit een rolstoel	24		
6.6 Een patiënt in een rolstoel zetten	25		
6.7 Een patiënt van en naar een toiletstoel verplaatsen	25		
6.8 Een patiënt van de vloer omhoog tillen	26		
7 Transport en opslag	27		
7.1 Algemene informatie	27		

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Gebruik dit product alleen als u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Ga voor meer informatie over het product en bij vragen over het juiste gebruik en eventuele aanpassing van het product naar een professionele zorgverlener die vertrouwd is met uw medische aandoening.

Omdat dit document betrekking heeft op alle beschikbare modellen (op de datum waarop dit document is gedrukt), zijn mogelijk niet alle delen relevant voor uw product. Indien niet expliciet anders wordt vermeld, verwijst elk hoofdstuk in dit document naar alle modellen van het product.

De modellen en uitvoeringen die in uw land beschikbaar zijn, zijn te vinden in de verkoopdocumenten van het desbetreffende land.

Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de laatste versie hebt. De meest recente versie vindt u als pdf-bestand op de Invacare-website.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u de pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

Neem voor meer informatie over het product, bijvoorbeeld meldingen over productveiligheid en teruggeroepen producten, contact op met uw Invacare-distributeur. Zie de adressen achter in dit document.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

1.1.1 Symbolen in dit document

In dit document worden symbolen en signaalwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of klein letsel als de situatie niet wordt vermeden.



KENNISGEVING

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan eigendommen als de situatie niet wordt vermeden.



Tips en adviezen

Hier worden nuttige tips, adviezen en informatie voor efficiënt, probleemloos gebruik gegeven.

Overige symbolen

(Niet op alle handleidingen van toepassing)



Verantwoordelijke persoon in het VK
Geeft aan of een product wel of niet in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd.



Triman
Wijst op de regels voor recycleren en sorteren (alleen voor Frankrijk).

1.2 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is acht jaar bij dagelijks gebruik en in overeenstemming met de veiligheidsinstructies, onderhoudstermijnen en bij correct gebruik, zoals aangegeven in deze handleiding. De effectieve levensduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik.

1.2.1 Aanvullende informatie

De verwachte levensduur wordt gebaseerd op een geschat gemiddelde van 4 liftcycli per dag.

1.3 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Verkeerd gebruik
- Normale slijtage
- Verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- Technische aanpassingen
- Niet-geautoriseerde wijzigingen en/of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen

1.4 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

1.5 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merkteken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse 1.

Dit product is voorzien van het UKCA-merkteken conform Deel II UK MDR 2022 (zoals aangepast) klasse 1.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

Wij leven de huidige milieuwetgevingen AEEA en RoHS na.

1.5.1 Productspecifieke normen

Het product is getest en voldoet aan de norm ISO 10535 (Tilliften voor het verplaatsen van gehandicapten) en alle bijbehorende normen.

Neem voor meer informatie over de lokale normen en voorschriften contact op met uw lokale Invacare-vertegenwoordiger. Zie de adressen achter in dit document.

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinformatie

Dit deel van de handleiding bevat algemene veiligheidsinformatie over uw product. Raadpleeg voor specifieke veiligheidsinformatie het betreffende deel van de handleiding en de procedures in dat deel.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur alleen als u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, met inbegrip van de gebruikshandleidingen of instructiebladen die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt. Als u de waarschuwingen, aandachtspunten of instructies niet begrijpt, dient u contact op te nemen met een zorgverlener, een Invacare-leverancier of een technisch medewerker voordat u dit product gaat gebruiken.
- Voer geen niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen uit aan het product.



WAARSCHUWING!

De maximale veilige belasting mag niet worden overschreden.

- De maximale veilige belasting van dit product en de gebruikte accessoires, zoals draagbanden en tiljukken, mag niet worden overschreden. Zie de documentatie of het etiket voor de vermelde maximale veilige belasting.
- Het onderdeel met de laagste maximale belastbaarheid is bepalend voor de maximale veilige belasting van het gehele systeem.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamelijk letsel.
- Verplaats een patiënt nooit zonder toestemming van de professionele zorgverlener van de patiënt.
 - Lees de instructies in deze gebruikershandleiding door en kijk eerst hoe de procedures voor het overplaatsen van patiënten worden uitgevoerd door getraind personeel. Oefen vervolgens zelf met het overplaatsen onder toezicht en met een geschikte persoon die de rol van patiënt speelt.
 - Wees bijzonder voorzichtig bij mensen met beperkingen, die niet kunnen helpen terwijl ze worden overgeplaatst.
 - Gebruik de patiëntenlift niet als vervoermiddel. De patiëntenlift is bedoeld voor het verplaatsen van een persoon van het ene rustoppervlak naar het andere.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Verkeerd gebruik van de kabels kan elektrische schokken of defecten aan het product veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u de kabels van het product niet knikt, afsnijdt of beschadigt.
 - Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het product geen kabels bekneld of beschadigd raken.
 - Zorg ervoor dat de bedrading en aansluitingen goed zijn aangelegd.
 - Gebruik geen apparatuur als u daartoe niet bevoegd bent.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Door te veel vocht kan het product beschadigd raken en kunnen er elektrische schokken optreden.
- De patiëntenlift kan in een badkamer worden gebruikt, maar mag NIET onder de douche worden gebruikt. De patiënt moet worden verplaatst naar een douchestoel of een ander hulpmiddel gebruiken voor het douchen.
 - Als de patiëntenlift wordt gebruikt in een vochtige omgeving, moet deze na gebruik worden afgedroogd.
 - Sluit het netsnoer niet aan en koppel het netsnoer niet los in een vochtige omgeving of met natte handen.
 - Bewaar het product niet in een vochtige ruimte of onder vochtige omstandigheden.
 - Inspecteer regelmatig alle onderdelen van het product op tekenen van corrosie of schade. Vervang onderdelen met corrosiesporen of schade.
 - Raadpleeg *11.4 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving, pagina 34*.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Ontstekingsbronnen kunnen brand of vuur veroorzaken.
- Tijdens het verplaatsen van een patiënt moet een veilige afstand worden bewaard tussen de patiëntenlift en mogelijke ontstekingsbronnen (zoals een kachel, fornuis of open haard).
 - Het is voor de patiënt en begeleiders verboden om tijdens het verplaatsen te roken.
 - De draagband mag niet boven of op een warmtebron worden gelegd (zoals een kachel, fornuis of open haard).



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

- Letsel of beschadiging tijdens het gebruik van het product voorkomen:
- Als het product wordt gebruikt in de buurt van kinderen of huisdieren, moeten zij nauwlettend in de gaten worden gehouden.
 - Laat kinderen niet met het product spelen.

**LET OP!****Risico op schade of lichamelijk letsel**


Het product kan heet worden bij blootstelling aan zonlicht of een andere warmtebron.

- Stel het product niet gedurende langere periodes bloot aan direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.

**KENNISGEVING!**

Het product kan defect raken als zich te veel pluis, stof of vuil op het product heeft opgebouwd.

- Houd het product schoon.

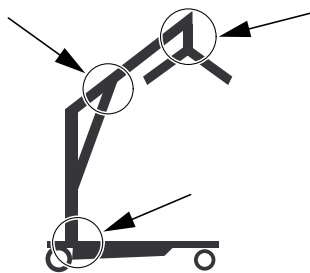2.1.1 Klempunten**WAARSCHUWING!****Gevaar voor lichamelijk letsel**

Er zijn op de lift verschillende bewegende onderdelen aanwezig waartussen uw vingers bekneld kunnen raken.

- Houd handen en vingers altijd uit de buurt van bewegende onderdelen.

2.2 Veiligheidsinformatie over accessoires**LET OP!****Gevaar voor lichamelijk letsel**

Niet-originele of onjuiste accessoires kunnen van invloed zijn op de werking en veiligheid van dit product.

- Omdat er verschillen zijn per regio, kunt u het beste de Invacare-website of -catalogus voor uw regio raadplegen voor de beschikbare accessoires. U kunt ook contact opnemen met uw Invacare-leverancier.
- Raadpleeg de handleiding bij de accessoires voor meer informatie en instructies.
- Gebruik alleen originele accessoires voor het product dat u gebruikt. In bepaalde omstandigheden is het gebruik van een draagband van een andere fabrikant echter wel mogelijk. Zie de aanvullende informatie in deze paragraaf.

**LET OP!****Compatibiliteit van draagbanden met het bevestigingssysteem**

Invacare gebruikt een normaal bevestigingssysteem met haken en lussen. De lussen aan de draagband worden bevestigd aan de haken op het tiljuk (type 'kleerhanger'). Daarom kunnen ook geschikte draagbanden van andere fabrikanten met deze patiëntenlift worden gebruikt.

- Gebruik uitsluitend draagbanden met lusbevestigingen die geschikt zijn voor een tiljuk (type 'kleerhanger') met haken.
- Gebruik geen draagbanden die zijn ontworpen voor 'systemen met sleutelgat- of klembevestiging' of 'systemen met kantelframe'.

Voor de keuze van een draagband moet een risicoanalyse worden gemaakt door een professionele zorgverlener. Bij de risicoanalyse moet het volgende in overweging worden genomen:

- Het gewicht, de omvang, het fysieke vermogen en de medische toestand van de patiënt.
- De wijze waarop de verplaatsing zal plaatsvinden en de omgeving.
- De compatibiliteit met de andere tilapparatuur die wordt gebruikt.

2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie**WAARSCHUWING!****Defecten mogelijk als gevolg van elektromagnetische interferentie**

Er kan elektromagnetische interferentie optreden tussen dit product en andere elektrische apparatuur. De elektrische afstel functies van dit product kunnen hierdoor verstoord worden. U kunt elektromagnetische interferentie op de volgende manieren voorkomen of verminderen:

- Gebruik alleen originele accessoires en reserve-onderdelen. Zo neemt de elektromagnetische emissie niet toe en neemt de elektromagnetische immuniteit van dit product niet af.
- Houd draagbare RF-communicatieapparatuur op ten minste 30 cm van de onderdelen van dit product (inclusief kabels).
- Gebruik dit product niet in de buurt van actieve hoogfrequente chirurgische apparatuur of een voor RF-straling afgeschermd MRI-ruimte, waar elektromagnetische storingen in hoge mate aanwezig zijn.
- Als er sprake is van storingen, vergroot u de afstand tussen dit product en de overige apparatuur of schakelt u die apparatuur uit.
- Raadpleeg de gedetailleerde informatie en volg de richtlijnen van hoofdstuk 12 *Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)*, pagina 35.



WAARSCHUWING!


Risico op storing

Elektromagnetische interferentie kan een onjuiste werking tot gevolg hebben.

- Gebruik dit product niet naast of gestapeld met andere elektrische apparatuur. Als het toch nodig is dit product op dergelijke wijze te gebruiken, moet u de werking van het product en de andere apparatuur goed in de gaten houden.

2.4 Typeplaatjes en symbolen op het product


2.4.1 Locatie van label

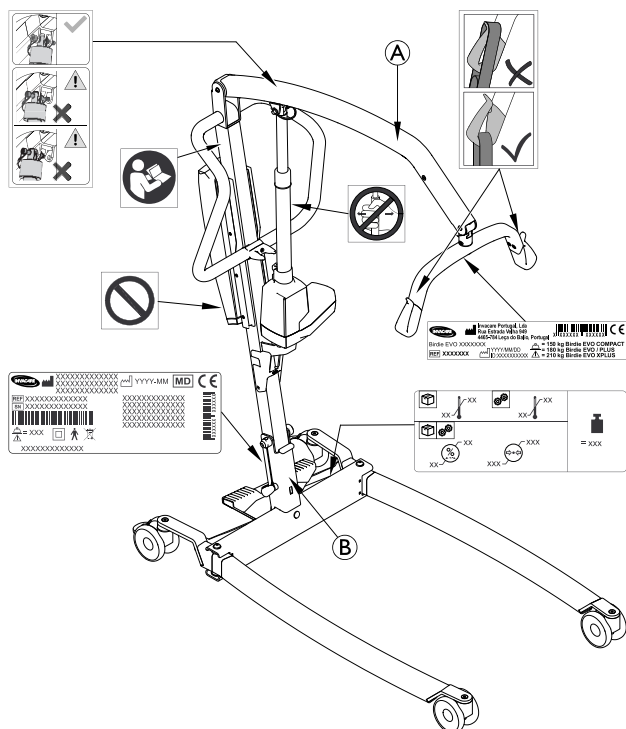

A	Naam en veilige belasting van de patiëntenlift – tekst afhankelijk van het model
B	Veilige belasting van de patiëntenlift – tekst afhankelijk van het model (alleen voor vaste mast)

Raadpleeg het volgende voor meer informatie over de labels.

2.4.2 Typeplaatje

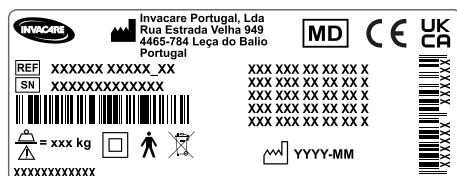

Het typeplaatje bevat de belangrijkste productinformatie, inclusief technische gegevens.

Symbolen	
	Medisch hulpmiddel
	Conformiteit met Europese normen
	Conformiteit VK beoordeeld
	Fabrikant
	Fabricagedatum
	Veilig te belasten tot max.
	Serienummer
	Referentienummer
	Veilig te belasten tot max.
	Klasse II-apparaat
	Type B-apparaat
	Conform AEEA

Afkortingen voor technische gegevens:

- lin = ingangsstroom
- Uin = ingangsspanning
- Int. = onderbrekingen
- AC = wisselstroom
- Max = maximum
- min = minuten

Zie 11 Technische Specificaties, pagina 32 voor meer informatie over de technische gegevens.

2.4.3 Overige labels en symbolen


Lees vóór gebruik van dit product de gebruikershandleiding en volg alle gebruiks- en veiligheidsinstructies op.

Oefen geen zijwaartse krachten uit op de actuator (bijv. door deze als duwstang te gebruiken); dit kan schade en storing tot gevolg hebben.




Verwijder dit label niet en kom niet aan de schroef onder het label; dit kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van het product.


De garantie voor het product komt te vervallen als dit label wordt verwijderd of kapot wordt gemaakt.

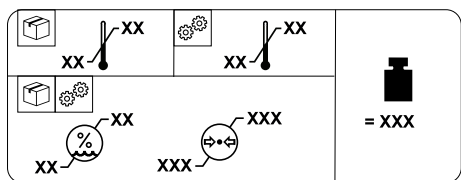

	Totale gewicht van het product met de maximale veilig toe te passen belasting
	Minimale/maximale temperatuur
	Minimale/maximale luchtvochtigheid
	Minimale/maximale atmosferische druk
	Voorwaarden voor transport en opslag
	Voorwaarden voor gebruik

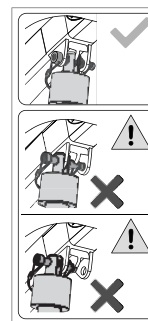

Zorg ervoor dat de actuator van de mast goed aan de giek is bevestigd.



Zorg altijd dat de draagband op de juiste manier aan de haken is bevestigd.

Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen*, pagina 22.

3 Productoverzicht

3.1 Bedoeld gebruik

De mobiele patiëntenlift is een apparaat dat op een accu werkt en is bedoeld voor het verplaatsen en positioneren van een persoon van het ene rustoppervlak naar het andere. Bijvoorbeeld:

- Tussen bed en rolstoel
- Van en naar het toilet
- Een patiënt vanaf de vloer omhoog tillen of laten zakken

De maximale veilige belasting staat vermeld in *11 Technische Specificaties, pagina 32*.

De mobiele patiëntenlift is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis op een vlak oppervlak, in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en thuis. De mobiele patiëntenlift kan worden gedraaid (om zijn as) voor het verplaatsen van patiënten in kleine ruimten.

De beoogde bediener van dit product is een zorgprofessional of een privépersoon die voldoende training heeft gehad.

Beoogde gebruikers

De beoogde gebruiker is een volledig of gedeeltelijk immobiel persoon.


Indicaties

De mobiele patiëntenlift is geïndiceerd voor personen die deels of volledig beperkt zijn in hun bewegingen en die niet handmatig kunnen worden verplaatst met behulp van andere typen liften of verplaatsingshulpmiddelen.

Alle positiewijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder hulp van de patiënt.


Voor dit product zijn geen contra-indicaties bekend.

3.2 Hoofdonderdelen van de lift

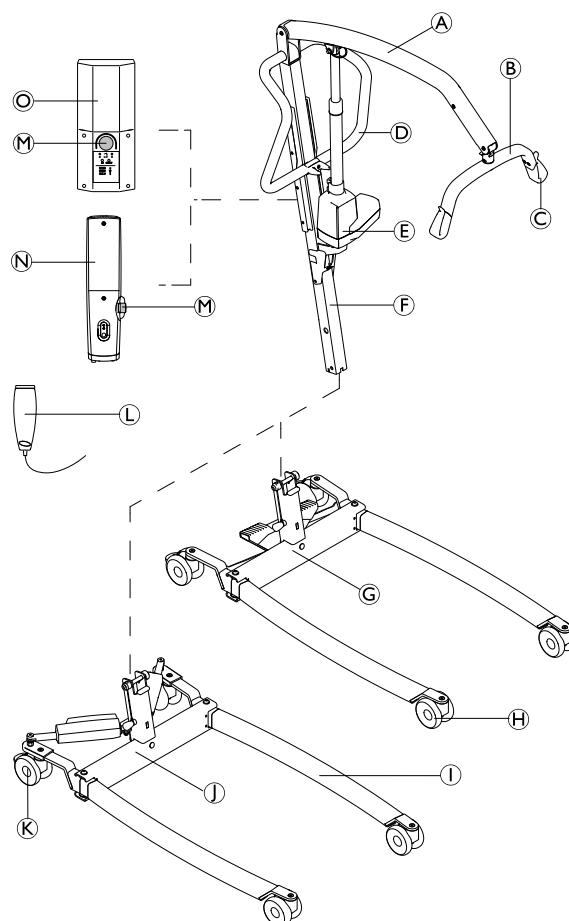

Ⓐ	Hefboom
Ⓑ	Tiljuk – met of zonder SMARTLOCK™
Ⓒ	Haak voor draagband
Ⓓ	Duwstang
Ⓔ	Liftactuator
Ⓕ	Mast – inklapbaar of vast
Ⓖ	Onderstel met voetpedaal voor handmatig uitklappen van poten
Ⓗ	Voorste zwenkwielen
Ⓘ	Poot
Ⓙ	Onderstel met actuatoren voor elektrisch uitklappen van poten – met of zonder actuatorbehuizing
Ⓚ	Achterste zwenkwielen met rem
Ⓛ	Handbediening
Ⓜ	Noodstop
Ⓝ	CBJ Home-bedieningseenheid met geïntegreerde accu
Ⓞ	CBJ Care-, CBJ1- of CBJ2-bedieningseenheid met afneembare accu

3.3 Accessoires

 Omdat er verschillen zijn per regio, kunt u het beste de Invacare-website of -catalogus voor uw regio raadplegen voor informatie over de beschikbare accessoires. U kunt ook contact opnemen met uw Invacare-leverancier.

- 4-punts tiljuk (type 'kleerhanger'), 450, 500 of 550 mm breed
- 2-punts tiljuk (type 'kleerhanger'), 350, 450 of 550 mm breed
- Hendel voor handmatig uitklappen van poten
- Muuroplader voor een afneembare accu
- Extra accu

- Beschermende kappen voor de poten
- Padding voor tiljuk

Draagbandmodellen met lusbevestigingen, geschikt voor tiljukken (type 'kleerhanger') met haken:

- Draagbanden voor ondersteuning van het hele lichaam - met of zonder hoofdsteun
- Draagbanden voor aankleden/toiletbezoek - met of zonder hoofdsteun
- Draagbanden voor geamputeerden

Weegschaal moet met het tiljuk worden gemonteerd:

- Wunder® CR200
- Wunder® RS300

4 Montage

4.1 Algemene veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

- Controleer vóór gebruik alle onderdelen op transportschade, zie *Dagelijkse controles*.
- Gebruik het apparaat niet als dit beschadigd is. Neem contact op met uw Invacare-leverancier voor verdere instructies.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- Een onjuiste montage kan tot letsel of schade leiden.
- Gebruik alleen onderdelen van Invacare voor de montage van deze patiëntenlift.
 - Controleer na elke montage of alle bevestigingen goed zijn vastgedraaid en of alle onderdelen correct functioneren.
 - Draai de schroeven of onderdelen niet te strak aan. Hierdoor kunnen de montagebeugels beschadigd raken.




Er is geen gereedschap nodig om de patiëntenlift te monteren.

Neem bij problemen tijdens de montage contact op met uw Invacare-leverancier.

4.2 Omvang van de levering

Welke onderdelen de verpakking bevat, hangt af van de modellen en uitvoeringen die in uw land beschikbaar zijn. Zie *Inleiding*

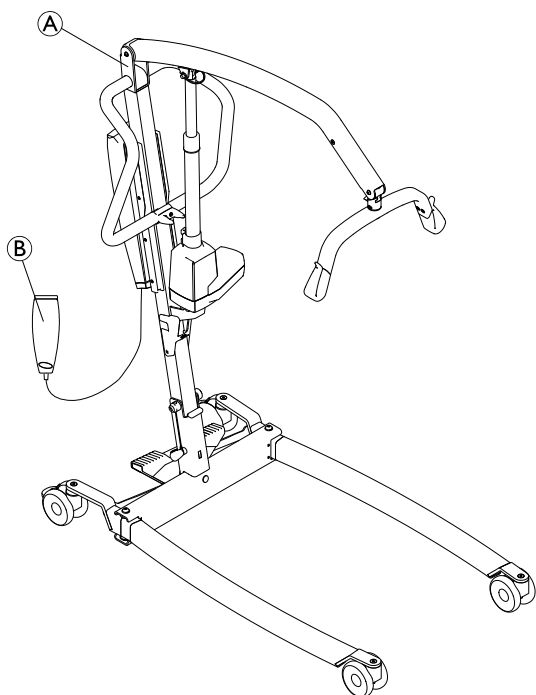

Ⓐ	Lift – inclusief onderstel, mast, hefboom, tiljuk, bedieningseenheid en actuatoren <ul style="list-style-type: none"> • Met inklapbare mast (1 stuk) • Met vaste mast (2 stuks) – onderstel als afzonderlijk onderdeel
Ⓑ	Handbediening (1 stuk)
	Voedingskabel (1 stuk)
	Gebruiksaanwijzing (1 stuk)
	Accu (1 stuk)* – alleen CBJ Care, CBJ1 en CBJ2
	Hendel voor handmatig uitklappen van poten (1 stuk)*
	Draagband (1 stuk)*

* Afhankelijk van model en/of uitvoering



Als de lift wordt geleverd met een draagband, dient u de gebruiksaanwijzing van de draagband te raadplegen voor instructies voor het gebruik, de toepassing, het onderhoud en het wassen van de draagband.

4.3 De mast installeren

4.3.1 De mast uitklappen


(alleen voor de inklapbare mast)




WAARSCHUWING!

- De mast kan worden ingeklapt voor opslag of transport. De mast MOET bij het inklappen altijd goed aan het onderstel worden bevestigd.
- Controleer vóór de montage alle onderdelen op zichtbare defecten en schade. Als het product beschadigd is, mag dit niet worden gebruikt en dient u contact op te nemen met uw Invacare-leverancier.
- De noodstop moet vóór montage of demontage worden geactiveerd.
- Wees voorzichtig bij het tillen van onderdelen tijdens de montage. Sommige onderdelen zijn zwaar. Neem altijd de juiste tilpositie aan.

Uitpakken en monteren moet altijd op de vloer plaatsvinden.

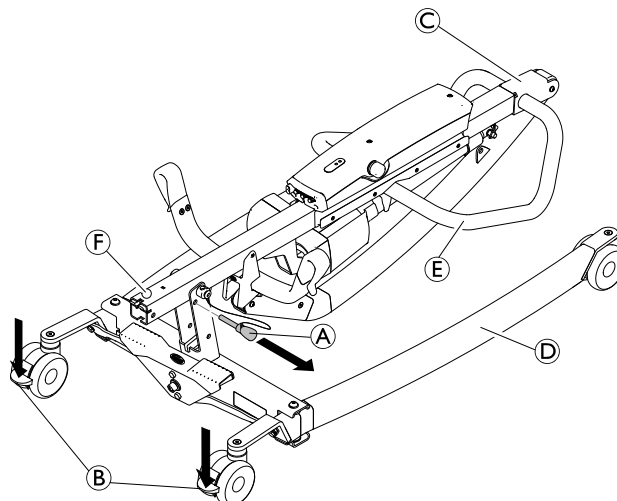

1. Vergrendel beide achterste zwenkwielen ⑥. Verwijder de vergrendelingspin ①.
2. Zet de mastconstructie ③ rechtop door met één voet op de poot ④ te gaan staan en de duwstang ⑤ omhoog te trekken totdat de veiligheidsvergrendeling ② op zijn plaats vastklikt.
- 3.

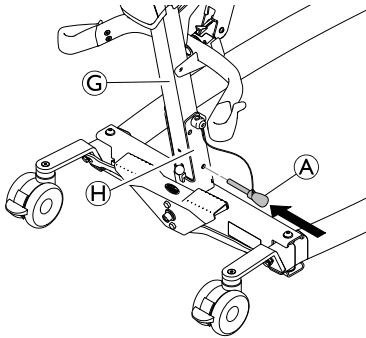

Plaats de vergrendelingspin ① terug door de mast ③ en het onderstel ④ heen. Controleer of de vergrendelingspin correct is geplaatst.

4.3.2 De mast op het onderstel monteren

(alleen voor de vaste mast)




WAARSCHUWING!

Risico op letsel of beschadiging


Op de hefboom en het onderstel moet dezelfde waarde staan bij 'Veilig te belasten tot maximaal'.
– Vergelijk deze aanduidingen op het onderstel en de hefboom altijd met elkaar.

1.

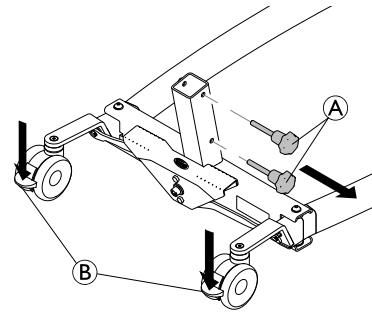

Vergrendel beide achterste zwenkwielen ⑥ en draai de schroeven met de hand linksom ① om ze van het onderstel te verwijderen.


2.

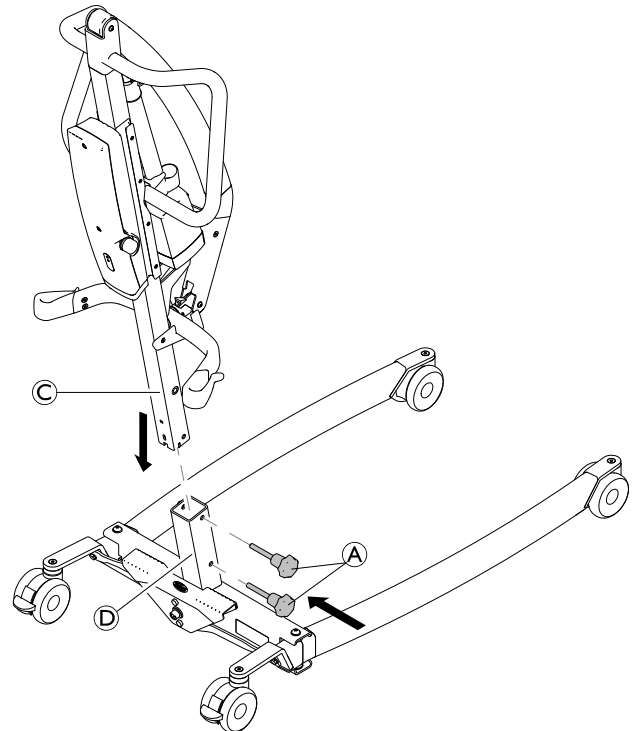

Zorg dat de hefboom naar voren wijst, laat mast ③ in de houder van onderstel ④ zakken en plaats de schroeven ① terug om mast ③ op het onderstel te bevestigen.


4.4 Het tiljuk uitklappen

1.

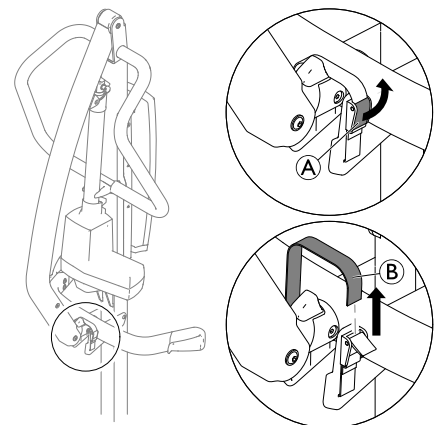


Open sluiting ① en haal bandje ② uit de gesp.

2.

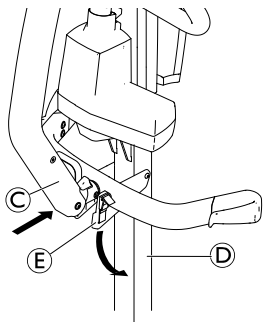


Houd hefboom ③ tegen mast ④ gedrukt en trek tiljuchouder ⑤ naar beneden.

3.

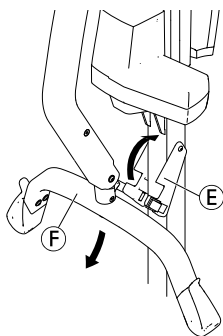


Klap tiljuk ⑥ omlaag en klap tiljukhouder ⑤ omhoog.

4.


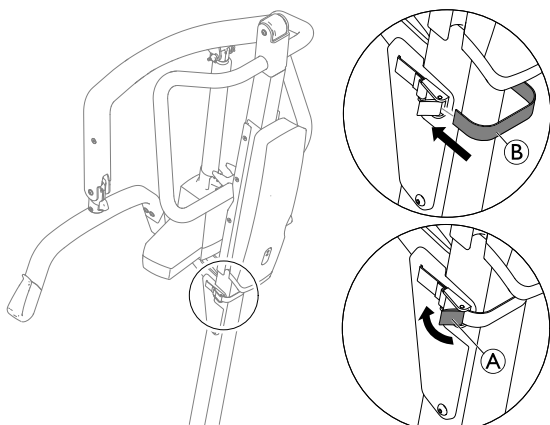


Haal band ⑥ langs de achterkant van de mast door de gesp en maak sluiting ⑦ dicht.

4.5 De actuator op de hefboom installeren

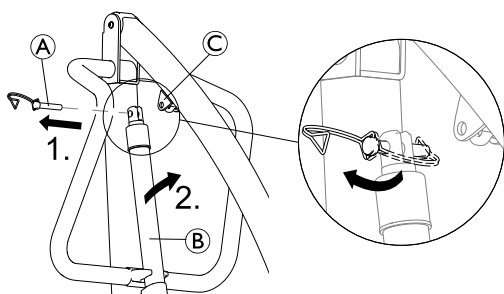

1. Maak de D-clip los en verwijder pin ① uit actuator ②.
2. Verwijder actuator ② uit de beugel op de mast en maak deze vast aan montagebeugel ③ van de hefboom.
- 3.

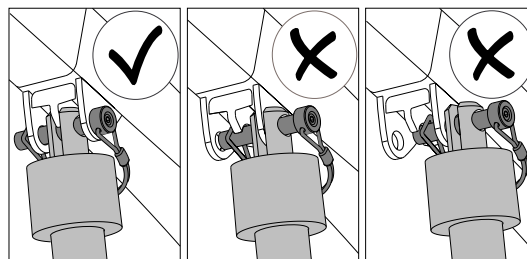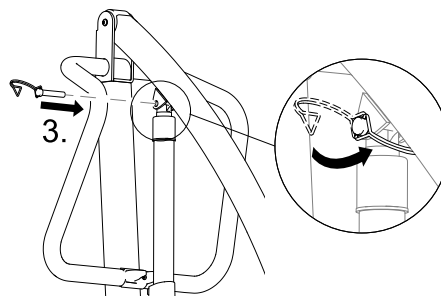


Lijn de gaten uit en breng de pin ① weer aan. Zorg ervoor dat de pin volledig is ingebracht en zet hem vast met de D-clip.

! KENNISGEVING!

- Voor de hogere belasting van de Birdie® EVO XPLUS is een langere pin nodig.
 - Gebruik de Birdie® EVO XPLUS alleen met de langere pin, te herkennen aan een zwarte D-clip.

4.6 Hendel voor handmatig uitklappen van poten installeren

 Dopsleutel van 2 x 13 mm

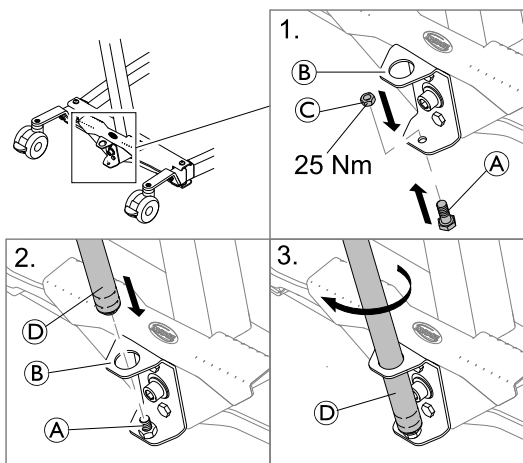

1. Steek bout ① van onderaf in het onderste gat van beugel ② en zet deze vast met moer ③.
2. Steek het schroefdraaduiteinde van hendel ④ in het bovenste gat van beugel ② op de bevestigde bout ①.
3. Schroef hendel ④ linksom vast op de bout.

- !** **KENNISGEVING!**
 Voor de hogere belasting van de Birdie® EVO XPLUS is een langere hendel nodig om de poten te openen en sluiten.
 – Gebruik de Birdie® EVO XPLUS alleen met de langere hendel.

4.7 De serviceteller resetten

(alleen voor de CBJ Care-bedieningseenheid)

- !** **KENNISGEVING!**
 Als het servicelampje geel knippert tijdens het dagelijkse gebruik of nadat de lift opnieuw in elkaar is gezet, is er onderhoud aan de lift vereist.
 – Neem voor onderhoud contact op met uw Invacare-leverancier.

Nadat de lift de eerste keer in elkaar is gezet, moet de serviceteller worden gereset voordat de lift wordt gebruikt.

De serviceteller de eerste keer resetten:

1. Pak de handbediening.
2. Houd de knoppen **OMHOOG** en **OMLAAG** tegelijkertijd gedurende vijf seconden ingedrukt.
3. Er is een geluid te horen zodra de serviceteller is gereset

5 Gebruik

5.1 Algemene veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Risico op letsel of beschadiging

Raadpleeg de volgende veiligheidsinformatie en -instructies voordat u de lift met een patiënt gebruikt:

- 2 Veiligheid, pagina 6
- 6 Verplaatsen van een patiënt, pagina 21

5.2 De achterste zwenkwielen vergrendelen/ontgrendelen




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

De lift kan kantelen waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat voor zowel de patiënt als de assistenten.

- Invacare raadt aan de vergrendeling van de achterste zwenkwielen niet in te schakelen tijdens het tillen en verplaatsen, zodat de patiëntenlift zichzelf kan stabiliseren als de patiënt in eerste instantie wordt opgetild en wordt verplaatst naar een stoel, bed of ander stilstaand object.
- Invacare raadt aan de vergrendeling van de achterste zwenkwielen van de lift alleen in te schakelen tijdens het positioneren en verwijderen van de draagband rond de patiënt.



- Druk pedaal **A** met uw voet naar beneden om de zwenkwielen te vergrendelen.
- Duw pedaal **A** omhoog met uw voet om de zwenkwielen te ontgrendelen.

5.3 Een elektrische lift omhoog of omlaag brengen

Met de handbediening kan de lift omhoog of omlaag worden gebracht.




WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Schade aan onderdelen van de lift (handbediening, zwenkwielen enz.) die is veroorzaakt door het raken van de vloer, muren of andere stilstaande objecten, kan schade aan het product en letsel veroorzaken.

- De giek NIET met de hand optillen.
- Gebruik ALTIJD de handbediening om de hefboom omhoog te brengen.



1. De lift omhoog brengen: houd de knop NAAR BOVEN **A** ingedrukt om de hefboom en de patiënt omhoog te brengen.
2. De lift omlaag brengen: houd de knop NAAR BENEDEN **B** ingedrukt om de hefboom en de patiënt omlaag te brengen.



Laat de knop los om de lift stil te zetten tijdens het omhoog of omlaag brengen.

5.4 De poten inklappen en uitklappen



WAARSCHUWING!


Risico op lichamelijk letsel

De lift kan kantelen waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat voor zowel de patiënt als de assistenten.

- De poten van de lift moeten maximaal worden uitgeklaapt voor optimale stabiliteit en veiligheid. Als u de poten van de lift moet inklappen om deze onder een bed te manoeuvreren, klapt u de poten in totdat de lift zich boven de patiënt bevindt en tilt u de patiënt uit bed. Als de poten van de lift zich niet meer onder het bed bevinden, klapt u de poten van de lift weer uit naar de maximaal geopende stand.

5.4.1 De elektrische poten in- en uitklappen

Met de handbediening kunnen de poten van het onderstel worden in- en uitgeklaapt.




1. Klap de poten in door de knop voor het inklappen van de poten **A** ingedrukt te houden.
2. Klap de poten uit door de knop voor het uitklappen van de poten **B** ingedrukt te houden.



De poten komen tot stilstand als u de knop loslaat.

5.4.2 De poten handmatig in- en uitklappen

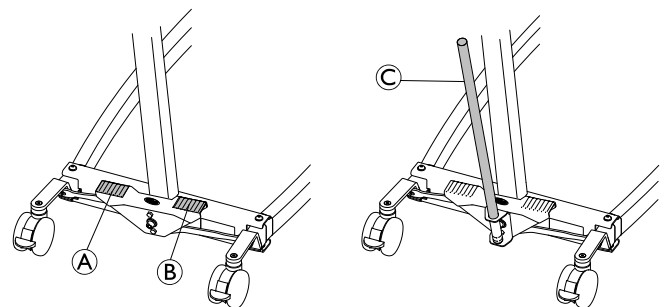

De poten kunnen handmatig worden in- en uitgeklaapt met behulp van twee pedalen (**A** en **B**) of met de hendel **C**.

1. Druk met een voet op het rechter pedaal **B** om de poten uit te klappen.
2. Druk met een voet op het linker pedaal **A** om de poten in te klappen.

Met de hendel:

1. Trek de hendel **C** naar rechts om de poten uit te klappen.
2. Duw de hendel **C** naar links om de poten in te klappen.

5.5 Het tiljuk vervangen

(alleen het tiljuk met SMARTLOCK™)




WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel

- Gebruik alleen tiljukken die zijn gemaakt voor deze lift.
- Controleer of het tiljuk geschikt is voor de patiënt en voor de vereiste wijze van tillen of verplaatsen.
- Controleer of het tiljuk stevig is bevestigd aan de hefboomconnector en niet kan worden verwijderd zonder de ontgrendelingsknop in te drukken.

Het tiljuk verwijderen


- 1.
- 2.

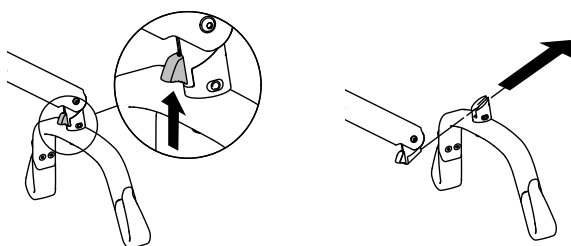

1. Druk de ontgrendelingsknop in en duw deze naar boven.
2. Schuif het tiljuk eruit in voorwaartse richting en enigszins naar boven gericht.


Een tiljuk bevestigen

1. Schuif het tiljuk erin tot u een klik hoort.
2. Controleer of het tiljuk stevig is bevestigd aan de hefboomconnector en niet kan worden verwijderd zonder de ontgrendelingsknop in te drukken.



5.6 Functies voor noodgevallen


5.6.1 Een noodstop uitvoeren

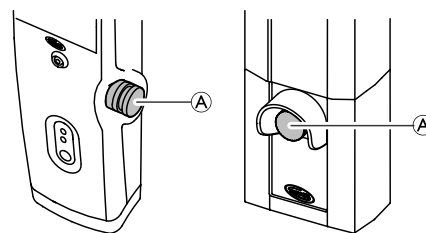

1. Druk op de rode noodstopknop **A** van de bedieningseenheid om te voorkomen dat de hefboom en de patiënt omhoog of omlaag gaan.
2. U kunt de noodstopknop weer resetten door deze rechtsonder te draaien.


5.6.2 De verlagingsfunctie activeren in een noodgeval (CBJ Home-bedieningseenheid)

Als de handbediening niet werkt, kan de hefboom omlaag worden gebracht met behulp van de ronde noodstopshakelaar.



1. Laat de hefboom zakken door knop **A** aan de voorzijde van de bedieningseenheid ingedrukt te houden.
2. Laat de knop los om de hefboom stil te zetten.


5.6.3 De verlagingsfunctie activeren in een noodgeval (bedieningseenheid van CBJ Care, CBJ1 en CBJ2)

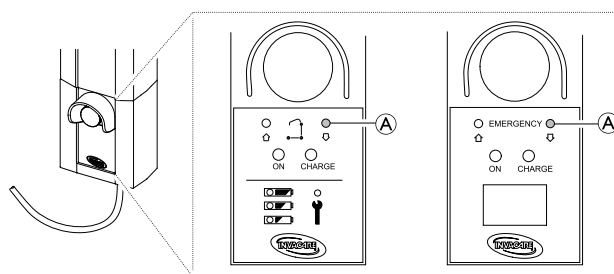

Als de handbediening niet werkt, kan de hefboom omlaag worden gebracht met behulp van de ronde noodstopshakelaar. Gebruik een scherp object, bijvoorbeeld een potlood, om de knop in te drukken.

1. Laat de hefboom zakken door knop **A** aan de voorzijde van de bedieningseenheid ingedrukt te houden.
2. Laat de knop los om de hefboom stil te zetten.

5.6.4 De optilfunctie activeren in een noodgeval (bedieningseenheid van CBJ Care en CBJ1)

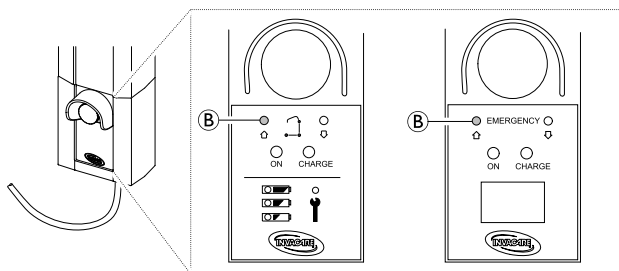

Als de handbediening niet werkt, kan de hefboom omhoog worden gebracht met behulp van de ronde noodschakelaar voor optillen. Gebruik een scherp object, bijvoorbeeld een potlood, om de knop in te drukken.

1. Breng de hefboom omhoog door de knop (B) aan de voorzijde van de bedieningseenheid ingedrukt te houden.
2. Laat de knop los om de hefboom stil te zetten.

5.6.5 Het verlagingsmechanisme activeren in een noodgeval

Als de noodverlaging op de bedieningseenheid niet werkt, is er een mechanische noodverlaging beschikbaar als reserve. Dit kan gebeuren bij een volledige of gedeeltelijke stroomstoring, of als de accu tijdens gebruik leeg raakt.



WAARSCHUWING!


Risico op letsel of beschadiging

Als de mechanische noodverlaging herhaaldelijk wordt gebruikt, neemt de verlagingsnelheid snel toe.

- Gebruik de mechanische noodverlaging alleen als reserve, wanneer de noodverlaging op de bedieningseenheid niet werkt.
- Gebruik de mechanische noodverlaging niet meerdere keren snel achter elkaar.
- Laat de patiënt altijd op een dragend oppervlak zakken, zoals een bed of stoel.
- Na een noodgedwongen gebruik van de mechanische noodverlaging moet de patiëntenlift worden gecontroleerd, zodat de storing van de bedieningseenheid kan worden verholpen.

Birdie® EVO en Birdie® EVO PLUS / XPLUS

1. Zoek de rode noodhandgreep (A) onderaan de zuiger van de actuator.
2. Trek de rode noodhandgreep (A) langzaam omhoog. Stop met trekken en houd de greep op zijn plek wanneer een veilige verlagingsnelheid is bereikt.
3. Als er niets gebeurt terwijl de noodhandgreep (A) helemaal omhoog is getrokken, druk dan tegelijkertijd de hefboom naar beneden.




De effectieve verlagingsnelheid is afhankelijk van het gewicht van de patiënt. Als de snelheid te laag of te hoog is, kan deze worden aangepast aan het gewicht van de patiënt. De verlagingsnelheid aanpassen:

1. Zoek de schroef in de opening aan de onderkant van de rode noodhandgreep (A).
2. Draai de schroef naar links om de snelheid te verhogen.
3. Draai de schroef naar rechts om de snelheid te verlagen.

Birdie® EVO COMPACT

(optioneel)

1. Zoek de rode noodstopknop (A) bovenaan de zuiger van de actuator.
2. Draai de noodstopknop (A) rechtop.



5.7 De accu opladen




KENNISGEVING!

- De noodstop mag niet zijn geactiveerd wanneer de accu wordt opgeladen.
- De accu moet worden opgeladen in een goed geventileerde ruimte.
- De elektrische functies werken niet wanneer de lift is aangesloten op de netvoeding.
- Gebruik de lift niet als de behuizing van de accu beschadigd is.
- Vervang een beschadigde accubehuizing voordat u de lift gaat gebruiken.
- De lift mag niet worden verplaatst als het netsnoer nog in het stopcontact zit.

De accu kan het beste dagelijks worden opgeladen. De lift kan dan optimaal worden gebruikt en de accu gaat langer mee. Daarnaast wordt aanbevolen om de accu op te laden voorafgaand aan het eerste gebruik.

5.7.1 CBJ Home-bedieningseenheid

De bedieningseenheid is voorzien van een geluidssignaal. Er klinkt een pieptoon als de accu bijna leeg is. Het is dan nog wel mogelijk om de patiënt te laten zakken. Het wordt aangeraden de accu op te laden zodra het geluidssignaal klinkt.



1. Steek de stekker van het netsnoer © in het stopcontact.


i De accu laadt op in ongeveer 4 uur. Het laden stopt automatisch als de accu volledig is opgeladen.

De bovenste gele diode A knippert tijdens het opladen en brandt continu als de accu volledig is opgeladen.

De onderste groene diode B blijft branden zo lang de bedieningseenheid is aangesloten op het stopcontact, en licht op als er een knop op de handbediening wordt ingedrukt of als de functie voor elektrisch zakken in noodgevallen wordt geactiveerd.

2. Haal de stekker uit het stopcontact als de accu volledig is opgeladen.

5.7.2 CBJ Care-, CBJ1-, CBJ2-bedieningseenheid

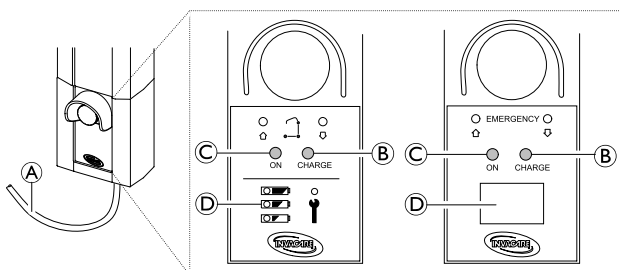

De bedieningseenheid is voorzien van een geluidssignaal. Er klinkt een pieptoon als de accu bijna leeg is. Het is dan nog wel mogelijk om de patiënt te laten zakken. Het wordt aangeraden de accu op te laden zodra het geluidssignaal klinkt.

1. Steek de stekker van het netsnoer A in het stopcontact.

i De accu laadt op in ongeveer 4 uur. Het laden stopt automatisch als de accu volledig is opgeladen.

De gele diode B (rechts) brandt continu tijdens het opladen en gaat uit als de accu volledig is opgeladen.

De groene diode C (links) brandt continu als de bedieningseenheid is aangesloten op het elektriciteitsnet.

2. Haal de stekker van het netsnoer A uit het stopcontact als de accu volledig is opgeladen.

Acculampje

De bedieningseenheid kan zijn uitgerust met een acculampje D, dat de resterende capaciteit van de accu aangeeft.

CBJ Care

Type acculampje	Accustatus	Omschrijving
	Volledig opgeladen	Er is voldoende spanning - opladen is niet nodig (50-100%). Het bovenste ledlampje is GROEN.
	Gedeeltelijk opgeladen	De accu moet worden opgeladen (25-50%). Het middelste ledlampje is GEEL.
	Nog niet opgeladen	De accu moet worden opgeladen (minder dan 25%). Er klinkt een akoestisch signaal als er een knop wordt ingedrukt. Het onderste ledlampje is GEEL.
	Nog niet opgeladen (led knippert)	De accu moet worden opgeladen. De lift werkt niet meer optimaal en de hefboom kan alleen nog omlaag worden gebracht.

CBJ1 en CBJ2 met lcd

Type acculampje	Accustatus	Omschrijving
	Volledig opgeladen (100%)	Er is voldoende spanning - opladen is niet nodig (100%).
	Gedeeltelijk opgeladen (75%)	Er is voldoende spanning - opladen is niet nodig (75%).
	Gedeeltelijk opgeladen (50%)	De accu moet worden opgeladen (50%).
	Nog niet opgeladen (25%)	De accu moet worden opgeladen (25%). Er klinkt een akoestisch signaal als er een knop wordt ingedrukt.
	Nog niet opgeladen (0%)	De accu moet worden opgeladen. De lift werkt niet meer optimaal en de hefboom kan alleen nog omlaag worden gebracht.

5.7.3 Optionele handbediening

Voor de CBJ Care is een handbediening met acculampje als optie verkrijgbaar.

Type acculampje	Accustatus	Omschrijving
	Volledig opgeladen	De accu heeft voldoende spanning - opladen is niet nodig (100-50%). Het ledlampje rechts is GROEN.
	Gedeeltelijk opgeladen	De accu moet worden opgeladen (50-25%). Het middelste ledlampje is GEEL.
	Nog niet opgeladen	De accu moet worden opgeladen (minder dan 25%). Er klinkt een akoestisch signaal als er een knop wordt ingedrukt. Het ledlampje links is GEEL.
	Nog niet opgeladen (led knippert)	De accu moet worden opgeladen. De lift werkt niet meer optimaal en de hefboom kan alleen nog omlaag worden gebracht.


5.7.4 Optionele acculader

(alleen voor bedieningseenheden met afneembare accu)

De procedure voor het verwijderen en installeren van de accu is hetzelfde voor de bedieningseenheid en de lader.

De accu verwijderen

1. 2.

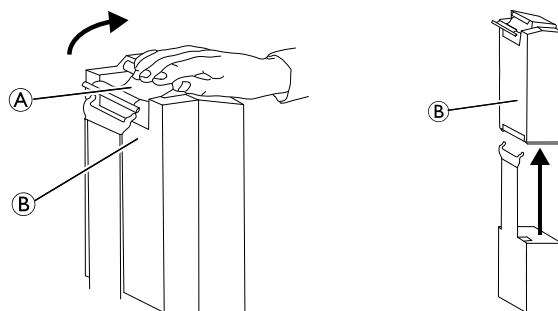

1. Houd de accu vast aan het handvat A achter op de accu B.
2. Til de accu omhoog uit de bedieningseenheid of de lader.


De accu plaatsen



LET OP!

Een onjuiste plaatsing van de accu kan leiden tot letsel of schade.
– U dient een klik te horen bij het plaatsen van de accu in de bedieningseenheid of de acculader.
Dit duidt op een correcte plaatsing.

1. Plaats de accu B op de bedieningseenheid of de lader zoals weergegeven, en verzeker u ervan dat u een klik hoort.

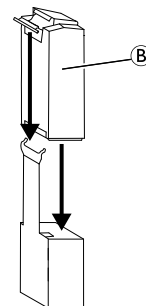

Wanneer de accu op de lader is geplaatst, gaat het oplaadlampje branden. Wanneer de accu is opgeladen, gaat het oplaadlampje uit.

Het duurt ongeveer vier uur om een lege accu volledig op te laden.

6 Verplaatsen van een patiënt

6.1 Algemene veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamenlijk letsel.

- Controleer voordat u een patiënt verplaatst naar een stilstaand object (rolstoel, bed, toiletstoel of een ander oppervlak) of dit object voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van de patiënt.
- Indien van toepassing moeten de remmen van de wielen of zwenkwielen van het stilstaande object (rolstoel, bed enzovoort) zijn geactiveerd voordat u de patiënt op het stilstaande object laat zakken of optilt van het stilstaande object.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamenlijk letsel.

- Gebruik altijd de duwstangen op de mast om de lift te duwen of te trekken.
- Gebruik de lift niet op een helling. Invacare adviseert het product alleen op een vlakke ondergrond te gebruiken.
- Tijdens het verplaatsen, wanneer de patiënt in de draagband van de lift hangt, mag u de lift NIET over ongelijke oppervlakken rollen, om te voorkomen dat de lift kantelt.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of beschadiging

Schade aan onderdelen van de lift (handbediening, zwenkwielen, enzovoort) die is veroorzaakt door het raken van de vloer, muren of andere stilstaande objecten, kan schade aan het product en letsel veroorzaken.

- Zorg dat de onderdelen van de lift GEEN vloeren, muren of andere stilstaande objecten raken.
- Berg de handbediening ALTIJD op wanneer deze niet wordt gebruikt.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamenlijk letsel

Het tiljuk kan plotseling in beweging komen, wat kan leiden tot letsel.

- Let bij het positioneren van de lift altijd op de positie van het tiljuk en de patiënt.



WAARSCHUWING!

Beknellings- of verstikkingsgevaar

Als het snoer van de handbediening niet goed geplaatst of bevestigd is, kan dit leiden tot lichamenlijk letsel.

- Let ALTIJD op de locatie van het snoer van de handbediening ten opzichte van de patiënt en de zorgverleners.
- Zorg dat de patiënt en zorgverleners NIET verstrikt raken in het snoer van de handbediening.
- De handbediening moet op de juiste manier worden bevestigd. Berg de handbediening ALTIJD op wanneer deze niet wordt gebruikt.



WAARSCHUWING!

Beknellings- of verstikkingsgevaar

Spullen in de omgeving van de patiënt kunnen tijdens het optillen bekneling of verstikking veroorzaken. Om bekneling of verstikking te voorkomen:

- Controleer voor het tillen of de patiënt niet ergens aan vastzit.



WAARSCHUWING!

Beknellingsgevaar

Het risico bestaat dat u bekneld raakt tussen het tiljuk en de draagband.

- Wees voorzichtig bij het tillen.
- Plaats bij het tillen NOOIT handen of vingers op of in de buurt van de haken.
- Zorg ervoor voordat u gaat tillen dat de handen en vingers van de patiënt zich niet in de buurt van de haken bevinden.



KENNISGEVING!

Alle verplaatsingsprocedures die hieronder worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd door één (1) assistent. Invacare raadt echter aan de procedures indien mogelijk met twee (2) assistenten uit te voeren.

6.2 Het omhoog tillen voorbereiden



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamenlijk letsel

Tijdens verplaatsingen en tijdens het gebruik van de lift kan de hefboom de patiënt of verzorgers raken en letsel veroorzaken.

- Let bij verplaatsingen ALTIJD op de positie van de hefboom.
- Zorg dat de hefboom zodanig is gepositioneerd dat deze geen patiënten of omstanders kan raken.
- Let bij verplaatsingen ALTIJD op uw eigen positie ten opzichte van de hefboom.

1. Voordat u verdergaat, moet u de informatie en alle waarschuwingen in *2 Veiligheid, pagina 6* en *De patiënt optillen* doornemen en in acht nemen.
2. Positioneer de patiënt in de draagband. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draagband.
3. Ontgrendel de achterste zwenkwielen. Raadpleeg *5 Gebruik, pagina 16*.
4. Klap de poten van de lift uit. Raadpleeg *5 Gebruik, pagina 16*.

5. Gebruik de duwstangen om de patiëntenlift in positie te brengen.



WAARSCHUWING!

- Wanneer u de lift samen met een bed of rolstoel gebruikt, moet u letten op de positie van de lift ten opzichte van de andere objecten, zodat de toegang tot de lift niet geblokkeerd raakt.
- Zorg dat er geen obstakels zijn wanneer u de poten van de patiëntenlift onder een bed plaatst.

6. Breng de patiëntenlift omlaag om de draagband gemakkelijk te kunnen bevestigen.
7. Vergrendel de achterste zwenkwielen. Zie 5 Gebruik, pagina 16
8. Bevestig de draagband. Zie 6.2.1 De draagband aan de patiëntenlift bevestigen, pagina 22

6.2.1 De draagband aan de patiëntenlift bevestigen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

Het gebruik van verkeerde of beschadigde draagbanden kan ertoe leiden dat de patiënt valt of de assistenten gewond raken.

- Gebruik een door Invacare goedgekeurde draagband die wordt aanbevolen door de arts, verpleegkundige of arts-assistent van de betrokkene om comfort en veiligheid te kunnen waarborgen voor de patiënt die moet worden verplaatst.
- Invacare-draagbanden en -accessoires voor patiëntenliften zijn specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met Invacare-patiëntenliften.
- Inspecteer de draagband(en) op slijtage, scheuren en losse naden na elke reinigingsbeurt (volgens de instructies op de draagband).
- Verbleekte, gescheurde, gerafelde en beschadigde draagbanden zijn onveilig en kunnen leiden tot letsel. Verwijder deze direct.
- Pas draagbanden NIET aan.



WAARSCHUWING!


Gevaar voor lichamelijk letsel

Het gebruik van onjuist bevestigde of aangepaste draagbanden kan ertoe leiden dat de patiënt valt of de assistenten gewond raken.


- Controleer de bevestigingspunten van de draagband telkens wanneer u deze verwijdert of verplaatst om ervoor te zorgen dat de band goed vastzit voordat u een patiënt uit een stilstaand object verwijdert (bed, stoel of toilet).
- Het tiljuk MOET aan de patiëntenlift worden bevestigd VOORDAT de draagband mag worden bevestigd.
- Gebruik GEEN enkel type kunststof incontinentieluier of zitkussen tussen de patiënt en het materiaal van de draagband waardoor de patiënt tijdens het verplaatsen uit de draagband zou kunnen glijden.

- Zorg er bij het optillen van een patiënt voor dat het hoofd voldoende wordt ondersteund.
- Plaats de patiënt in de draagband volgens de instructies die bij de draagband zijn geleverd.
- Zorg ervoor dat u alle aanpassingen voor de veiligheid en het comfort voor de patiënt hebt ingesteld voordat u de patiënt gaat verplaatsen.


De bevestigingsbandjes aan de draagband kunnen lussen bevatten in verschillende kleuren die verschillende lengtes aangeven. Hiervan kan gebruik worden gemaakt om de patiënt in verschillende posities te plaatsen. De kortere bevestigingsbandjes bij de schouders zorgen voor een meer verticale positie die de overplaatsing naar een stoel of rolstoel vergemakkelijkt. Door deze bandjes bij de schouders langer te maken, wordt een meer achterover hellende hoek verkregen waarin de overplaatsing naar een stoel of bed beter mogelijk is. Bevestig steeds de twee lussen met dezelfde kleur aan weerszijden van de draagband zodat de patiënt bij het omhoog tillen niet scheef hangt.

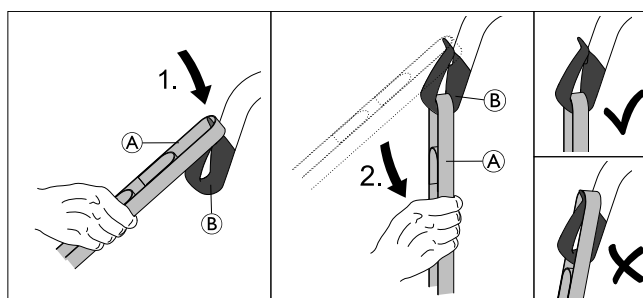

1. Leg de gekozen lus van bevestigingsbandje A over de punt van haak B.
2. Trek het bevestigingsbandje A zo ver omlaag dat het helemaal aan de onderkant van haak B komt te zitten.
3. Herhaal deze stappen voor elk van de overige bevestigingsbandjes van de draagband.
 - a. Bevestig de schouderband C op een 2-punts tiljuk voor de beenband D aan elk van de haken.

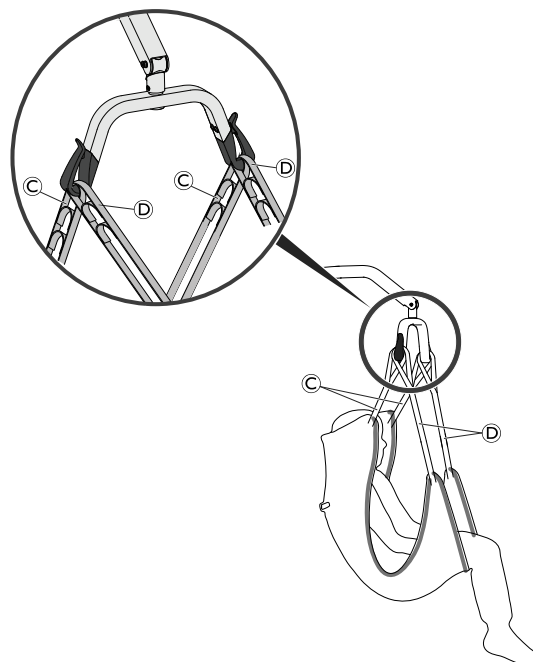


- b. Bevestig de bevestigingsbandjes elk aan een afzonderlijke haak op een 4-punts tiljuk.

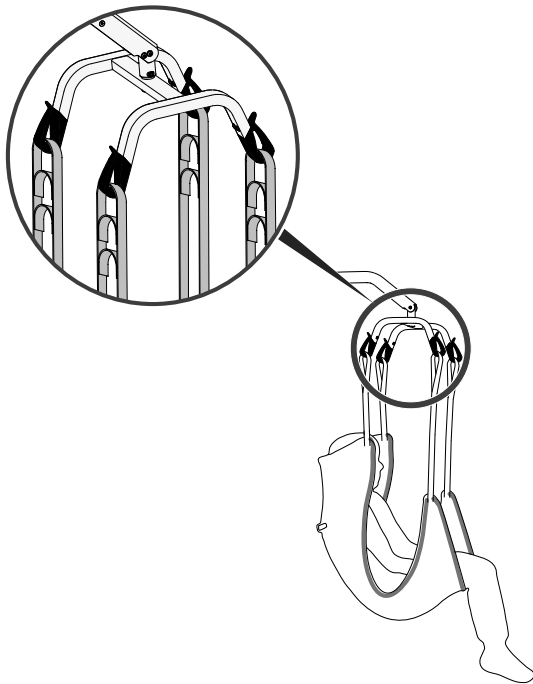


6.3 De patiënt vanaf een bed verplaatsen

1. Bereid het omhoog tillen voor. Raadpleeg 6.2 *Het omhoog tillen voorbereiden*, pagina 21.
2. Bevestig de draagband aan de lift. Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen*, pagina 22.
3. Ontgrendel de achterste zwenkwielen.
- 4.

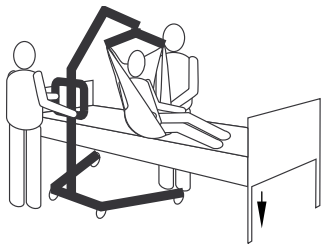

Laat het bed zakken tot de laagste positie.


5.

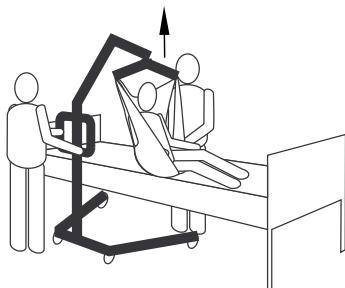

Til de patiënt voldoende hoog op om het stilstaande object vrij te maken terwijl zijn/haar gewicht volledig wordt ondersteund door de lift.

i De hefboom blijft in deze positie totdat de knop OMLAAG wordt ingedrukt.

6.

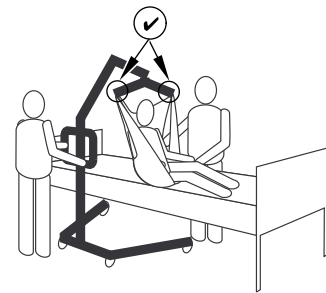

Controleer voor het verplaatsen van de patiënt nogmaals of de draagband goed is bevestigd aan de haken van het tiljuk. Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen*, pagina 22. Als u merkt dat bevestigingspunten niet goed vastzitten, laat u de patiënt weer op het stilstaende object zakken en verhelpt u het probleem.

7.



Verplaats de lift met behulp van de duwstangen uit de buurt van het stilstaende object.

8.



Draai de patiënt met de handgrepen op de draagband zodanig dat hij/zij de assistent die de patiëntenlift bedient, aankijkt.


9.



Laat de patiënt zakken zodat zijn/haar voeten op het onderstel van de lift rusten, schrijlings langs de mast.

i Het lage zwaartepunt zorgt voor meer stabiliteit waardoor de patiënt zich veiliger voelt en de lift makkelijker kan worden verplaatst.

10.

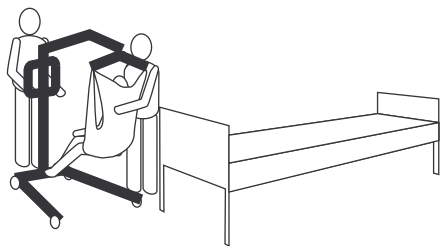

Verplaats de patiëntenlift met beide handen stevig op de duwstangen.

11. Ga verder met het verplaatsen naar een ander rustoppervlak of stilstaand object.

6.4 Een patiënt naar een bed verplaatsen


1. Voer de volgende stappen uit naast de stappen die nodig zijn om de patiënt van een ander rustoppervlak of stilstaand object op te tillen.

2.



Breng de lift omhoog of omlaag om de patiënt boven het stilstaande oppervlak te positioneren. Breng de patiënt zodanig omhoog of omlaag dat deze eenvoudig over de zijkanten van het stilstaande object kan worden getild.

3.




Laat de patiënt zakken op het stilstaande oppervlak.

4. Controleer of de patiënt volledig wordt ondersteund door het oppervlak waarnaar u de patiënt verplaatst.

5. Vergrendel de achterste zwenkwielen.

6. Verhoog het bed naar een goede werkhoogte (doorgaans de heuphoogte van de zorgverleners).


7.

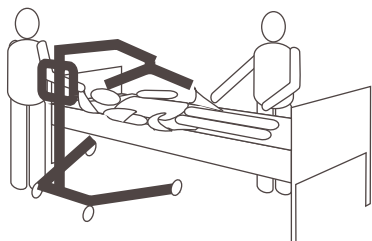

Maak de draagband los van het tiljuk.

8. Ontgrendel de achterste zwenkwielen.

9.

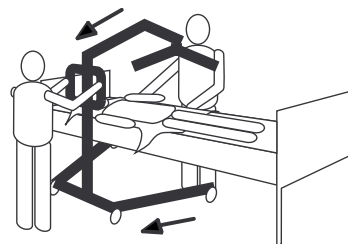

Beweeg de lift weg van de zone.

6.5 Een patiënt overplaatsen vanuit een rolstoel

1. Schakel de parkeerremmen van de rolstoel in om te voorkomen dat deze onbedoeld wordt verplaatst.


2. Bereid het omhoog tillen voor. Raadpleeg 6.2 *Het omhoog tillen voorbereiden*, pagina 21.

3. Plaats de rolstoel tussen de opengeklapte poten van de patiëntenlift, met de patiënt kijkend in de richting van de mast.

4. Bevestig de draagband aan de patiëntenlift. Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen*, pagina 22.


5. Ontgrendel de achterste zwenkwielen.

6.



Breng de hefboom zo ver omhoog dat er spanning komt te staan op de bevestigingsbandjes van de draagband en controleer of de draagband goed is bevestigd aan de haken van het tiljuk. Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen*, pagina 22. Als u merkt dat bevestigingspunten niet goed vastzitten, laat u de patiënt weer in de rolstoel zakken en verhelpt u het probleem.

7.



Til de patiënt voldoende omhoog om de rolstoelzitting vrij te maken terwijl zijn/haar gewicht volledig wordt ondersteund door de patiëntenlift.

8. Verplaats de patiëntenlift met behulp van de duwstangen uit de buurt van de rolstoel.

9. Ga verder met het verplaatsen naar een ander rustoppervlak of stilstaand object.

6.6 Een patiënt in een rolstoel zetten




WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

- Controleer voordat u de patiënt verplaatst of de rolstoel voldoende draagvermogen heeft voor het gewicht van de patiënt.
- De rolstoel MOET op de rem staan voordat u de patiënt laat zakken in de rolstoel voor transport.

1. Voer de volgende stappen uit naast de stappen die nodig zijn om de patiënt van een ander rustoppervlak of stilstaand object op te tillen.
2. Schakel de parkeerremmen van de rolstoel in om te voorkomen dat deze onbedoeld wordt verplaatst.
3. Positioneer de patiënt boven de zitting van de stoel met zijn of haar rug tegen de achterzijde van de stoel.
- 4.

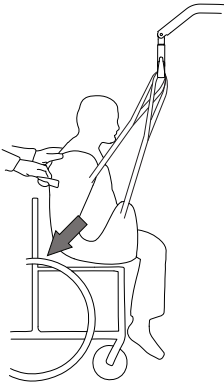


Laat de patiënt zakken en gebruik de handgreep (op bepaalde modellen) of de zijkanten van de draagband om de heupen van de patiënt zo ver mogelijk naar achteren in de stoel te plaatsen voor een juiste positionering. Op die manier wordt een goed evenwicht bewaard en kan de stoel niet naar voren kantelen.

6.7 Een patiënt van en naar een toiletstoel verplaatsen


- i** De Invacare-patiëntenlift is GEEN vervoermiddel. Wanneer de badkamer zich NIET in de buurt van het bed bevindt of wanneer de patiënt niet gemakkelijk naar de toiletstoel kan worden verplaatst, MOET de patiënt in een rolstoel worden verplaatst en naar de badkamer worden gebracht, waarna de patiënt met de patiëntenlift op een standaard toiletstoel kan worden geplaatst.
- i** De draagbanden met toiletopeningen zijn ontworpen om te worden gebruikt met een toiletrolstoel of een standaard toiletstoel.
- i** Voordat de patiënt wordt verplaatst, dient u de patiëntenlift mee te nemen naar de badkamer om te controleren of de lift gemakkelijk tot bij de toiletstoel kan komen.

1. Voer de volgende stappen uit naast de stappen die nodig zijn om de patiënt van een ander rustoppervlak of stilstaand object op te tillen.
- 2.

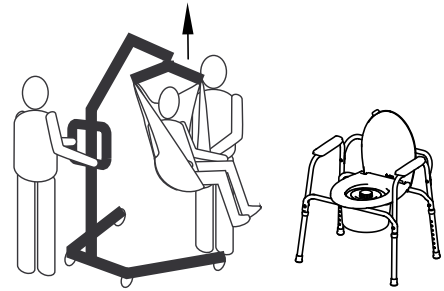


Til de patiënt voldoende omhoog om de armen van de toiletstoel vrij te maken, waarbij het gewicht van de patiënt volledig wordt ondersteund door de patiëntenlift. Zie 5 Gebruik, pagina 16

- 3.




Zorg dat de lift met de poten aan de buitenkant van de poten van de toiletstoel staat en de duwstangen van de lift zich tegenover de toiletstoel bevinden. Laat de patiënt plaatsnemen op de toiletstoel.

- 4.



Laat de patiënt zakken op de toiletstoel waarbij de draagband aan de haken van het tiljuk bevestigd dienen te blijven. Invacare raadt aan de draagband aan de haken van het tiljuk te laten terwijl de patiënt een toiletrolstoel of een standaard toiletstoel gebruikt.


- 5.



Wanneer de patiënt klaar is, controleert u nogmaals of de draagband correct is bevestigd.

6. Til de patiënt omhoog van de toiletstoel.

7.



Wanneer de patiënt van het oppervlak van de toiletstoel is verwijderd, gebruikt u de duwstangen om de lift bij de toiletstoel vandaan te bewegen.

8. Ga verder met het verplaatsen naar een ander rustoppervlak of stilstaand object.

6.8 Een patiënt van de vloer omhoog tillen




WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

De lift kan een patiënt die op de vloer ligt of een assistent die op de vloer werkt, verwonden.


- Ga altijd voorzichtig te werk wanneer u onderdelen van de lift verplaatst die zich in de buurt van een persoon op de vloer bevinden.

1. Controleer na een val of de patiënt mogelijk gewond is geraakt. Wanneer geen medische zorg noodzakelijk is, gaat u verder met het verplaatsen.
- 2.

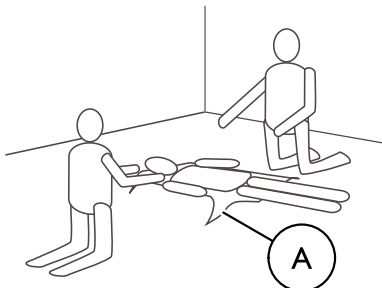

Plaats de draagband **A** onder de patiënt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draagband voor meer informatie over het plaatsen van draagbanden.


3.

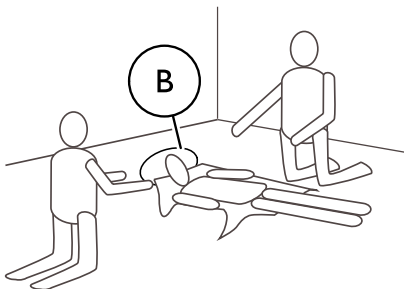

Laat de patiënt zijn/haar knieën buigen en zijn/haar hoofd van de vloer tillen terwijl u het hoofd van de patiënt ondersteunt met een kussen **B**.


4. Ontgrendel de achterste zwenkwielen. Zie 5 *Gebruik, pagina 16*
5. Klap de poten van de lift uit. Zie 5 *Gebruik, pagina 16*

6.

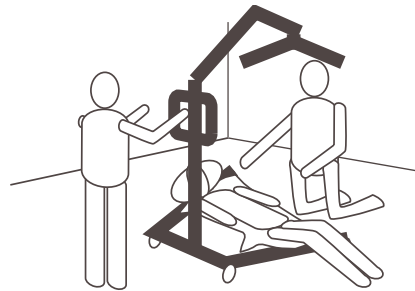


Plaats de lift met één poot onder de gebogen knieën van de patiënt en met de andere poot onder het hoofd van de patiënt. Houd de bevestigingsbanden van de draagband binnen het bereik van de poten van de lift.

7.

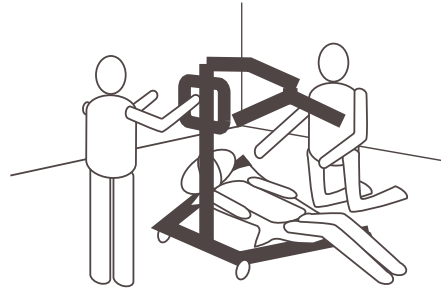

Breng de hefboom omlaag zodat het tiljuk zich precies boven de borstkas van de patiënt bevindt.

8.

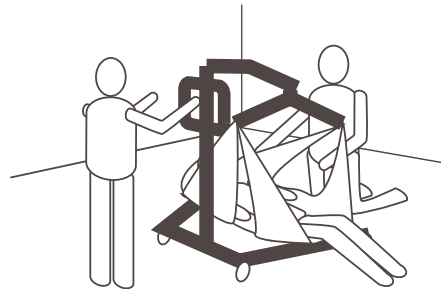

Bevestig de draagband. Raadpleeg 6.2.1 *De draagband aan de patiëntenlift bevestigen, pagina 22*.

9. Breng de hefboom omhoog om de patiënt van de vloer te tillen.
10. Ga verder met het verplaatsen naar een ander rustoppervlak of stilstaand object.

7 Transport en opslag

7.1 Algemene informatie

De noodstopknop moet worden ingedrukt tijdens transport en wanneer de patiëntenlift enige tijd niet wordt gebruikt.

Een ingeklapte of gedemonteerde lift kan worden getransporteerd of bewaard in de verpakkingendoos.

Een ingeklapte lift kan aan de achterwielen worden voortgetrokken en liften met een handmatige voorziening voor het uitklappen van poten kunnen rechttop worden geparkeerd, met de mast/hefboom naar boven gericht.

De patiëntenlift moet bij kamertemperatuur worden opgeslagen. In een vochtige, koude of natte omgeving kunnen de motor en andere montageonderdelen gaan roesten. Raadpleeg *11.4 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving*, pagina 34.

7.2 De mast losmaken van het onderstel

(alleen voor de vaste mast)

1. Verwijder de optionele hendel voor het uitklappen van de poten, indien deze is bevestigd.
2. Breng de hefboom omlaag en klap beide poten volledig in.
3. Activeer de noodstopknop en zet de remmen op de zwenkwielen.
4. Voer de procedure die wordt beschreven in *4.5 De actuator op de hefboom installeren*, pagina 14, in omgekeerde volgorde uit.
5. Voer de procedure die wordt beschreven in *4.4 Het tiljuk uitklappen*, pagina 13, in omgekeerde volgorde uit.
6. Voer de procedure die wordt beschreven in *4.3.2 De mast op het onderstel monteren*, pagina 13, in omgekeerde volgorde uit.

7.3 De mast inklappen

(alleen voor de inklapbare mast)


1. Verwijder de optionele hendel voor het uitklappen van de poten, indien deze is bevestigd.
2. Laat met de handbediening de giek zakken (zorg ervoor dat de actuator volledig is ingetrokken) en versmal beide poten volledig.
3. Activeer de noodstopknop en zet de remmen op de zwenkwielen.
4. Voer de procedure die wordt beschreven in , in omgekeerde volgorde uit. *4.5 De actuator op de hefboom installeren*, pagina 14
5. Voer de procedure die wordt beschreven in *4.4 Het tiljuk uitklappen*, pagina 13, in omgekeerde volgorde uit (zorg ervoor dat de actuator volledig is ingetrokken).
6. Voer de procedure die wordt beschreven in *4.3.1 De mast uitklappen*, pagina 12, in omgekeerde volgorde uit en trek de veiligheidsvergrendeling ⑤ omhoog voordat u de mast inklapt.

7.4 Mastverlengstuk voor rechttop zetten van de lift

(Alleen Birdie EVO)


Er is een magnetisch mastverlengstuk meegeleverd waarmee de lift rechttop kan worden gezet. Hiervoor moet er een elektrisch mechanisme voor het uitklappen van de poten op de lift zijn aangebracht.

1.

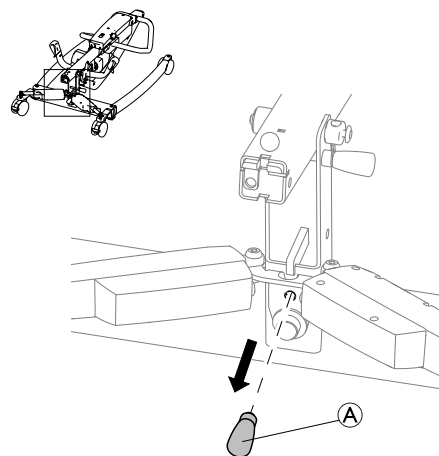


Haal het mastverlengstuk ① uit de plek op het onderstel van de lift waarin het is opgeborgen.

2.

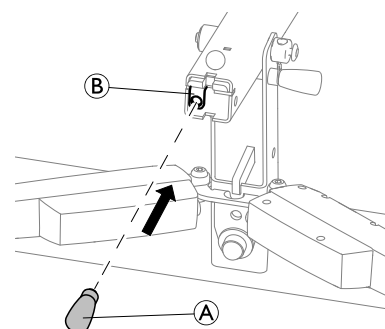

Steek het mastverlengstuk ① in de houder ② op de onderkant van de ingeklapte mast.

3.

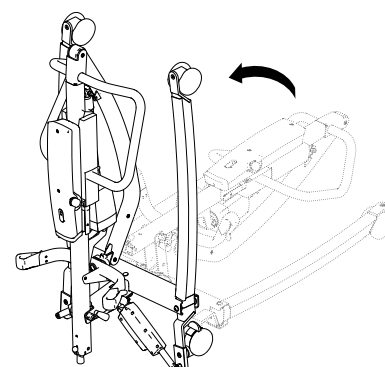

De ingeklapte lift kan nu rechttop worden gezet.

8 Onderhoud

8.1 Algemene informatie over onderhoud



LET OP!

Risico op letsel of beschadiging

- Voer geen onderhouds- of reparatieprocedures uit terwijl het product in gebruik is.

Volg de onderhoudsprocedures die worden beschreven in deze handleiding voor een maximale productiviteit en levensduur van uw product.

In de servicehandleiding worden verdere procedures voor onderhoud en inspectie beschreven, die door een gekwalificeerde monteur moeten worden uitgevoerd. Servicehandleidingen zijn verkrijgbaar via Invacare.

8.2 Dagelijkse controles



WAARSCHUWING!

Risico op letsel of beschadiging

- Beschadigde en versleten onderdelen kunnen de veiligheid van de lift aantasten.
- De patiëntenlift dient bij elk gebruik te worden gecontroleerd.
 - Gebruik de lift niet als deze beschadigd is of als u vermoedt dat bepaalde onderdelen van de lift onveilig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw Invacare-leverancier en zorg ervoor dat de lift niet wordt gebruikt totdat deze is gerepareerd.

Lijst dagelijkse controle

- Voer een visuele controle uit op de patiëntenlift. Controleer alle onderdelen op externe schade of slijtage.
- Controleer alle materialen, bevestigingspunten en onderdelen die onder spanning komen te staan, zoals de draagbanden, haken en alle draaipunten, op slijtage, breuken, rafeling, vervorming en verslechtering.
- Controleer of de handbediening werkt (tillen en pootbewegingen).
- Laad de accu elke dag dat de lift wordt gebruikt.
- Controleer de noodstopfunctie.
- Controleer het servicelampje (alleen de CBJ Care-bedieningseenheid).



Het servicelampje wordt aangegeven met een dopsleutelsymbool op de bedieningseenheid en op de handbediening, indien van toepassing.

- Als het servicelampje geel knippert, is er onderhoud aan de lift vereist. Gebruik de lift niet en neem contact op met uw Invacare-leverancier voor onderhoud.
- Als het servicelampje niet knippert, is de lift klaar voor gebruik.

8.3 Reiniging en desinfectie

8.3.1 Algemene veiligheidsinformatie



LET OP!

Besmettingsgevaar

- Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.



LET OP!

Risico op elektrische schokken en beschadiging van het product

- Schakel het apparaat uit en haal indien van toepassing de stekker uit het stopcontact.
- Houd bij het reinigen van elektrische onderdelen rekening met de betreffende beschermingsgraad tegen het binnendringen van water.
- Zorg dat er geen water op de stekker of het stopcontact spat.
- Raak de contactdoos niet aan als u natte handen hebt.



KENNISGEVING!

Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.

- Alle gebruikte reinigings- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
- Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen. We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
- Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
- Zorg er altijd voor dat het product volledig droog is voordat dit weer in gebruik wordt genomen.



Volg voor reiniging en desinfectie in klinische omgevingen of omgevingen voor langdurige zorg de intern ingestelde procedures.

8.3.2 Reinigingsintervallen



KENNISGEVING!

Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting.

Reinig en desinfecteer dit product:

- regelmatig tijdens gebruik,
- voor en na onderhoudswerkzaamheden;
- als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
- voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

8.3.3 Reinigingsinstructies



KENNISGEVING!

- Het product mag niet worden gereinigd in geautomatiseerde wasinrichtingen, met hogedrukreinigingsapparatuur of met stoom.

De lift reinigen

Methode: afnemen met een vochtige doek of zachte borstel.

Max. temperatuur: 40 °C

Oplosmiddel: een normaal huishoudelijk reinigingsmiddel en water.

Drogen: afdrogen met een zachte doek.

De draagband reinigen

Raadpleeg de wasinstructies op de draagband en de handleiding bij de draagband voor informatie over het reinigen.

8.3.4 Instructies voor desinfecteren

Verzorging thuis

- Desinfectiemiddel: We raden aan een desinfectiemiddel op basis van alcohol te gebruiken (met 70-90% alcohol).



Lees de instructies op het label van het desinfectiemiddel. Hier vindt u informatie over het werkingsspectrum (bacteriën, schimmels en/of virussen), compatibiliteit van materialen en de juiste blootstellingstijd.

1. Controleer of de oppervlakken schoon zijn voordat u deze desinfecteert.
2. Bevochtig een zachte doek met desinfectiemiddel en veeg over alle toegankelijke oppervlakken. Houd deze vochtig gedurende de blootstellingstijd die staat vermeld op het label van het desinfecteermiddel.
3. Laat het product aan de lucht drogen.

Verzorging in een instelling

Volg de desinfectieprocedures van uw instelling op en gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen en -methoden die hierin worden vermeld.

8.4 Periodiek onderhoud



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.

- Neem voor onderhoud contact op met Invacare.

Er moet minimaal eens per 12 maanden onderhoud worden uitgevoerd, tenzij anders vermeld in lokale vereisten.

9 Na gebruik

9.1 Afvoeren



WAARSCHUWING!

Potentieel schadelijk voor het milieu

Dit hulpmiddel bevat accu's.

Dit product bevat mogelijk stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze worden achtergelaten op plaatsen (stortplaatsen) die volgens de wetgeving daarvoor niet geschikt zijn.

- Gooi de accu's NIET weg met normaal huishoudelijk afval.
- Gooi de accu's NIET in het vuur.
- De accu's MOETEN naar een daarvoor bestemd afvalverwerkingsstation worden gebracht. Het inleveren van accu's is wettelijk verplicht; er zijn geen kosten aan verbonden.
- Voer alleen lege accu's af.
- Dek bij lithiumaccu's die afgevoerd moeten worden de contactpunten af.
- Meer informatie over het soort accu vindt u op het label van de accu of in hoofdstuk 11 *Technische Specificaties, pagina 32*.

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

9.2 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:


- Schoonmaken en desinfecteren
- Inspectie volgens het onderhoudsplan

Raadpleeg voor meer informatie over inspectie, reiniging en desinfectie de gebruikershandleiding en servicehandleiding bij dit product.

10 Problemen oplossen


10.1 Defecten en mogelijke oplossingen identificeren

Symptomen	Defecten	Oplossing
Patiëntenlift voelt los aan.	Aansluiting mast/onderstel zit los.	Raadpleeg De mast installeren in het hoofdstuk Installatie.
	De trekstangen zitten los.	Neem contact op met uw Invacare-leverancier.
De zwenkwielen/remmen maken lawaai of zijn stroef.	Pluisjes of verontreinigingen in de lagers.	Verwijder pluisjes en verontreinigingen van de zwenkwielen.
Lawaai of droog geluid van de scharnierpunten.	De scharnierpunten zijn versleten of beschadigd.	Neem contact op met uw Invacare-leverancier.
Elektrische actuator zorgt niet voor vereiste lift of poten klappen niet uit bij drukken op de knop.	De aansluiting van de handbediening of actuator zit los.	Maak de aansluiting van de handbediening of actuator vast. Controleer of de aansluitingen goed en volledig zijn geplaatst.
	Accu bijna leeg.	Laad de accu op. Zie 5.7 <i>De accu opladen, pagina 18</i>
	Noodstopknop is ingedrukt.	Draai de noodstopknop rechtsom totdat deze omhoog komt.
	Accu niet op de juiste manier aangesloten op bedieningseenheid.	Sluit de accu opnieuw aan op de bedieningseenheid. Zie 5.7.4 <i>Optionele acculader, pagina 20</i>
	De aansluitpunten zijn beschadigd.	Neem contact op met uw Invacare-leverancier.
	Netsnoer aangesloten op een stopcontact.	Koppel het netsnoer los van het stopcontact.
	De hefboom of pootactuator is beschadigd.	Neem contact op met uw Invacare-leverancier.
	Max. belasting is overschreden.	Verminder de last.
Ongebruikelijk geluid van de actuator.	De actuator is beschadigd.	Neem contact op met uw Invacare-leverancier.
De hefboom zakt niet meer omlaag als deze het hoogste punt heeft bereikt.	De hefboom moet enigszins worden belast om te kunnen zakken vanuit het hoogste punt.	Trek licht aan de hefboom.
Tijdens het tillen klinkt er een pieptoon vanuit de bedieningseenheid en de motor stopt.	Max. belasting is overschreden.	Verminder de belasting (zodat de lift weer normaal functioneert).


 Neem contact op met uw Invacare-leverancier als de problemen hiermee niet kunnen worden opgelost.

11 Technische Specificaties

11.1 Maximale veilige belasting

	Birdie® EVO	Birdie® EVO COMPACT	Birdie® EVO PLUS	Birdie® EVO XPLUS
Maximale veilige belasting (patiënt + tiljuk + draagband)	180 kg	150 kg	180 kg	210 kg

11.2 Afmetingen en gewichten

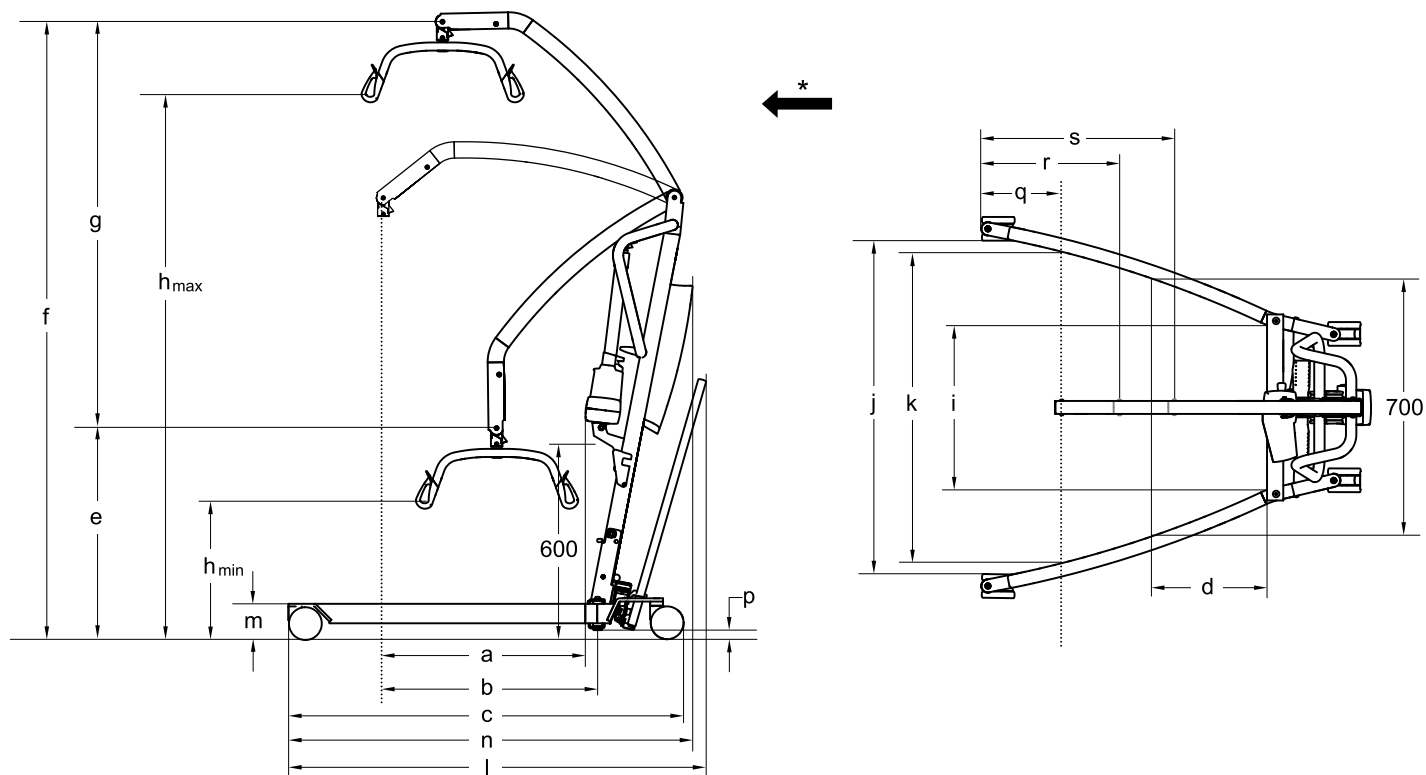


* Voorwaartse richting

Afmetingen (mm)	Birdie® EVO		Birdie® EVO COMPACT		Birdie® EVO PLUS / XPLUS
Diameter voorste/achterste zwenkwiel	75 / 75	100 / 100	75 / 75	100 / 100	100 / 125
Max. reikwijdte op 600 mm (a)	630	630	530	530	630
Max. reikwijdte vanaf onderstel (b)	630	630	530	530	630
Lengte van onderstel (c)	1200	1220	1060	1080	1280
Totale lengte zonder hendel (n)	1250	1250	1100	1100	1280
Totale lengte met hendel (l)	1290	1290	1140	1140	1350
Bereik vanaf onderstel met poten uitgeklaapt tot 700 mm (d)	225	225	420	420	225
Min. hoogte CSP*/laagste stand (e)	630	645	730	745	645
Max. hoogte CSP* (f)	1870	1885	1805	1820	1885
Tilbereik (g)	1240	1240	1060	1060	1240
Min. hoogte van draagbandbevestiging (h _{min})	400	415	515	530	415
Max. hoogte van draagbandbevestiging (h _{max})	1645	1660	1575	1590	1660
Totale breedte (poten uitgeklaapt) hart op hart van zwenkwielen (j)	1100	1100	890	890	1100

Afmetingen (mm)	Birdie® EVO		Birdie® EVO COMPACT		Birdie® EVO PLUS / XPLUS
Totale breedte (poten uitgeklaapt), binnenmaat (j)	1040	1020	835	815	1020
Totale breedte (poten ingeklapt), buitenmaat	640	640	520	520	640
Min. binnenbreedte (i)	495	495	380	380	495
Binnenbreedte bij maximale reikwijdte (k)	960	960	765	765	960
Draaidiameter zonder hendel	1400	1400	1210	1210	1430
Draaidiameter met hendel	1400	1400	1245	1245	1470
Hoogte tot bovenrand van poten (m)	100	115	100	115	115
Min. vrije hoogte (p)	20	35	20	35	35
Minimale afstand van muur tot CSP* bij maximaal bereik (poten uitgeklaapt) (q)	245	245	210	210	245
Minimale afstand van muur tot CSP* bij maximale hoogte (poten uitgeklaapt) (r)	410	410	450	450	410
Minimale afstand van muur tot CSP* bij minimale hoogte (poten uitgeklaapt) (s)	615	615	395	395	615
Hoogte wanneer ingeklapt (alleen inklapbare versie)	455	470	455	470	470
Lengte wanneer ingeklapt (alleen inklapbare versie)	1300	1320	1190	1210	1360

* CSP = centraal ophangpunt

 Alle afmetingen zijn gemeten met een 2-punts tiljuk van 450 mm.

Gewicht hoofdonderdelen (kg)	Birdie® EVO		Birdie® EVO COMPACT		Birdie® EVO PLUS / XPLUS
Totaal gewicht zonder tiljuk	40		31		41
Gewicht mast, met accu, zonder tiljuk	19		14		19
Gewicht basis, handmatig	21		17		22
Gewicht basis, elektrisch	21		n.v.t.		22

Gewicht tiljuk (kg)	
2-punts tiljuk, 350 mm	1,3
2-punts tiljuk, 450 mm	1,4
2-punts tiljuk, 550 mm	1,6
4-punts tiljuk, 450 mm	2,8
4-punts tiljuk, 500 mm	2,9
4-punts tiljuk, 550 mm	3,0

11.3 Elektrisch systeem


	Birdie® EVO	Birdie® EVO COMPACT	Birdie® EVO PLUS / XPLUS
Uitgangsspanning	24 V DC, max. 250 VA		
Ingangsspanning	100 – 240 V AC, 50/60 Hz		
Maximale ingangsstroom	400 mA (voor CBJ1, CBJ2 en CBJ Care) / 280 mA (voor CBJ Home)	400 mA (voor CBJ2) / 280 mA (voor CBJ Home)	400 mA (CBJ1 en CBJ Care) / 280 mA (voor CBJ Home)
Beveiligingsklasse (hele apparaat)	IPX4*		

	Birdie® EVO	Birdie® EVO COMPACT	Birdie® EVO PLUS / XPLUS
Isolatieklasse	Klasse II-apparaat		
Type B-apparaat	Toegepast onderdeel voldoet aan de opgegeven vereisten voor bescherming tegen elektrische schokken in overeenstemming met IEC60601-1.		
Geluidsniveau	45 – 50 dB (A)		
Werkvermogen	40 keer volledig tillen (met de accu tussen 100% - 50% van het volledige vermogen)		
Met onderbrekingen (periodieke motorfunctie)	10%, max. 2 min/18 min		
Specificaties accu	2 x 12 V/2,9 Ah		
Accutype	Loodzuur (onderhoudsvrij, afgesloten)		
Handmatig zakken in noodgevallen	Ja (onderaan de actuator)	Optioneel (bovenaan de actuator)	Ja (onderaan de actuator)
Elektrisch zakken/tillen in noodgevallen	Ja/ja (voor CBJ1 en CBJ Care) Ja/nee (voor CBJ2 en CBJ Home)	Ja/nee (voor CBJ2 en CBJ Home)	Ja/ja (CBJ1 en CBJ Care) Ja/nee (CBJ Home)
Stroomverbruik	tijdens het opladen: max. 19 W in de stand-bystand: max. 2,5 W		
Tilsnelheid - zonder belasting	35 mm/s	28 mm/s	47 mm/s
Tilsnelheid - met een persoon van 80 kg	30 mm/s	23 mm/s	40 mm/s

*IPx4 - het systeem is beschermd tegen water dat vanuit een willekeurige richting tegen de onderdelen spat.

11.4 Voorwaarden voor de gebruiksomgeving

	Opslag en transport	Bediening
Temperatuur	-10 °C tot +50 °C	+5 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	20% tot 80%, niet-condenserend	
Atmosferische druk	700 hPa tot 1060 hPa	

 Laat het product voor gebruik op bedrijfstemperatuur komen:

- na opslag bij de minimumopslagtemperatuur kan het opwarmen tot de bedrijfstemperatuur meer dan 30 minuten duren.
- na opslag bij de maximumopslagtemperatuur kan het afkoelen tot de bedrijfstemperatuur meer dan 5 minuten duren.

11.5 Materialen

Onderdeel	Materiaal
Onderstel, poten, mast en hefboom	Staal (met poedercoating)
Tiljuk	Staal (met poedercoating) en TPU

Onderdeel	Materiaal
Behuizing actuator, handbediening, mastbeschermer, zwenkwielen en andere kunststof onderdelen	Materiaal volgens markering (PA, PP, PE)
Hefboomconnector, bouten en moeren	Staal, verzinkt

Alle onderdelen van het product zijn roestwerend of roestbestendig.

11.6 Duwkracht op bedieningselementen

Bedieningselement	Duwkracht
Knoppen op de bedieningseenheid	4 N
Knoppen op de handbediening	4 N
Voetpedaal*	max. 290 N
Hendel voor uitklappen van poten op Birdie® EVO/Birdie® EVO COMPACT	max. 50 N
Hendel voor uitklappen van poten op Birdie® EVO XPLUS	max. 95 N

* Een hendel voor het uitklappen van poten is verplicht voor de Birdie® EVO met zwenkwielen van 75 mm en voor de Birdie® EVO XPLUS met handmatig uitklappen van poten.

12 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

12.1 Algemene informatie over EMC

Elektrische medische apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de EMC-informatie in deze handleiding.

Tests hebben uitgewezen dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijnen volgens IEC/EN 60601-1-2 voor apparatuur van klasse B.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van dit product beïnvloeden.

Bij andere apparaten kan er al van interferentie sprake zijn bij zeer lage elektromagnetische straling, zelfs als wordt voldaan aan bovengenoemde richtlijnen. Om te kunnen bepalen of emissie uit dit product de oorzaak is van de interferentie, schakelt u het product in en weer uit. Als er bij uitschakeling van dit product geen interferentie meer optreedt, is het product de oorzaak van de interferentie. In dit soort zeldzame gevallen kunt u het volgende doen om de interferentie te verminderen of te stoppen:

- Draai of verplaats het product, of vergroot de afstand tussen de apparaten.

12.2 Elektromagnetische straling

Richtlijn en verklaring van de fabrikant

Dit product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit product moet zeker stellen dat dit in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.


RF-emisietest	Naleving	Elektromagnetische omgeving – richtlijn
RF-emissies CISPR 11	Groep I	Dit product gebruikt elektromagnetische energie uitsluitend voor de interne functies. Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze hoogstwaarschijnlijk geen interferentie in nabije apparaten.
RF-emissies CISPR 11	Klasse B	Dit product is geschikt voor gebruik in alle situaties, inclusief thuishituaties en overal waar het openbare laagspanningsnet de stroom levert voor huishoudelijke doeleinden.
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spanningsfluctuaties/ flikkeremissies IEC 61000-3-3	Voldoet	

12.3 Elektromagnetische immuuniteit

Richtlijn en verklaring van de fabrikant

Dit product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit product moet zeker stellen dat dit in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuuniteitstest	Testniveau/ mate van overeenkomst	Elektromagnetische omgeving– richtlijn
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of tegels zijn. Als vloeren zijn bekleed met synthetische vloerbedekking, moet de relatieve vochtigheid minstens 30% bedragen.
Elektrostatische transiënt/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor stroomtoevoerkabels; 100 kHz herhaalfrequentie ± 1 kV voor input-/outputkabels; 100 kHz herhaalfrequentie	De kwaliteit van de netstroom moet overeenkomen met die van een commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.
Overspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV kabel naar kabel ± 2 kV kabel naar aarde	De kwaliteit van de netstroom moet overeenkomen met die van een commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.

Immunitiestest	Testniveau/ mate van overeenkomst	Elektromagnetische omgeving– richtlijn
Spanningsdips, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op stroomtoevoerkabels IEC 61000-4-11	<p>< 0% U_T gedurende 0,5 cyclus in stappen van 45°</p> <p>0% U_T gedurende 1 cyclus</p> <p>70% U_T gedurende 25/30 cycli</p> <p>< 5% U_T gedurende 250/300 cycli</p>	<p>De kwaliteit van de netstroom moet overeenkomen met die van een commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van dit product continue beschikbaarheid vereist gedurende netspanningsonderbrekingen, wordt aangeraden het product van voeding te voorzien met een noodstroomvoorziening (UPS, Uninterruptable Power Supply) of een accu.</p> <p>U_T is de netspanning vóór toepassing van de test.</p>
Magnetisch veld van netstroomfrequentie (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Magnetische velden van de netspanningsfrequentie moeten op een niveau liggen dat kenmerkend is voor een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.
<p>Geleidings-RF IEC 61000-4-6</p> <p>Stralings-RF IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V 150 kHz - 80 Mhz</p> <p>6 V binnen bandbreedtes voor ISM en amateurradio</p> <p>10 V/m 80 Mhz - 2,7 GHz</p> <p>Zie tabel 9 van IEC 60601-1-2:2014 voor specificaties van de 385 MHz - 5785 MHz-test met betrekking tot immuniteit voor draadloze RF-communicatie-apparatuur.</p>	<p>De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor draadloze telefonie, mobilofoons, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en tv-zenders kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de invloed van vaste RF-zenders op de elektromagnetische omgeving te bepalen, moet een elektromagnetisch veldonderzoek worden overwogen. Indien de gemeten veldsterkte op de locatie waar het product wordt gebruikt de eerdergenoemde toegestane elektromagnetische waarden overstijgt, moet dit product worden geobserveerd om normaal functioneren vast te stellen. Als abnormaal functioneren wordt geconstateerd, zijn wellicht extra maatregelen nodig, zoals het verdraaien of verplaatsen van het product.</p> <p>Interferentie kan optreden in de nabijheid van apparatuur met het volgende symbool: </p> <p>Houd draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur op ten minste 30 cm van de onderdelen van dit product (inclusief kabels).</p>



Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen.

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Neuhofweg 51
CH-4147 Aesch BL
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 488 19 10
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

España:

Invacare S.A.
Avenida del Oeste, 50 – 1º-1ª
Valencia-46001
Tel: (34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
servizioclienti@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Norge:

Besøksadresse:
(Office addresses)
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Tel: (47) 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Norge:

Vareleveringsadresse:
(Storage / Teknical dep)
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo
teknisk@invacare.com
www.invacare.no

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (+351) 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Australia:

Invacare Australia Pty. Ltd.
Unit 18/12 Stanton Road,
Seven Hills, NSW 2147,
Australia
Phone: 1800 460 460
Fax: 1800 814 367
orders@invacare.com.au
www.invacare.com.au

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 69 80
serviceclient_export@invacare.com
www.invacare.eu.com

New Zealand:

Invacare New Zealand Ltd
4 Westfield Place, Mt Wellington
1060
New Zealand
Phone: 0800 468 222
Fax: 0800 807 788
sales@invacare.co.nz
www.invacare.co.nz



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

60128525-C 2023-04-28



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®